Pile Dynamics, Inc.

Transducer 392W

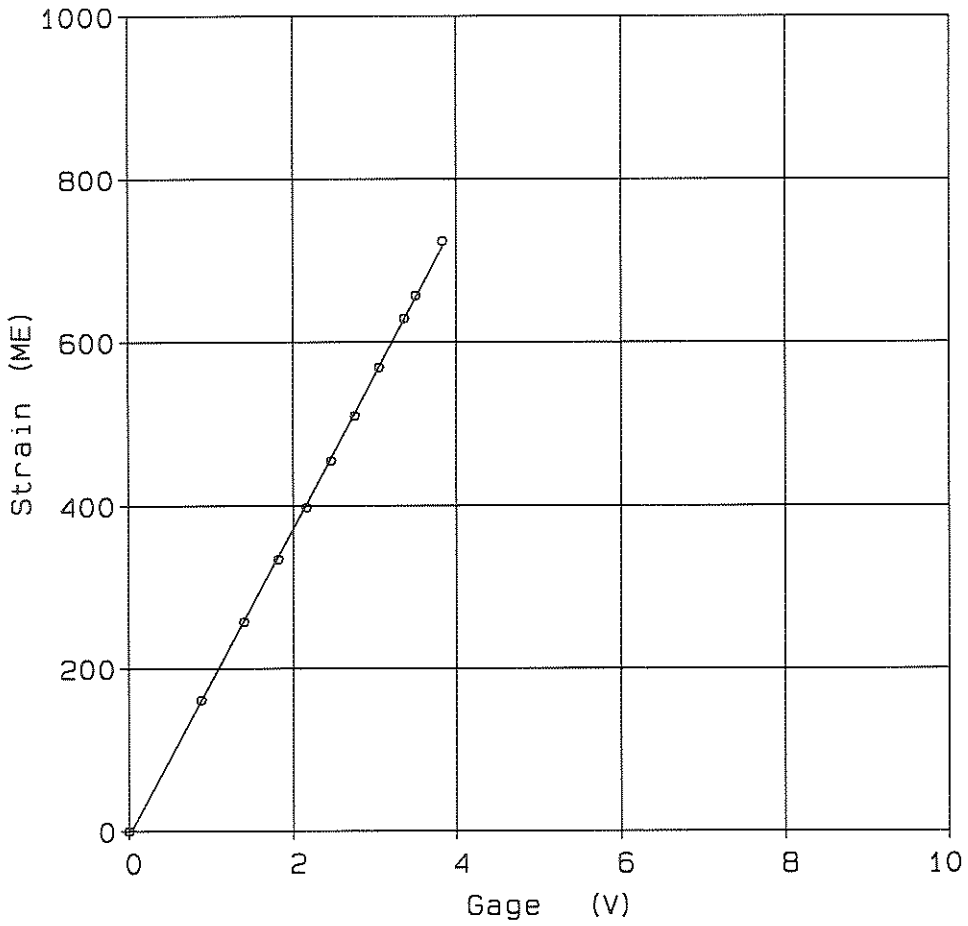

PDA Cal Factor = 188.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 654.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
161	.89
257	1.41
335	1.82
398	2.16
455	2.46
511	2.75
569	3.06
629	3.37
657	3.51
724	3.84

Calibrated by: J.S. Tomkiewicz

Calibrated on: 27-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2