Pile Dynamics, Inc.
Transducer 393W

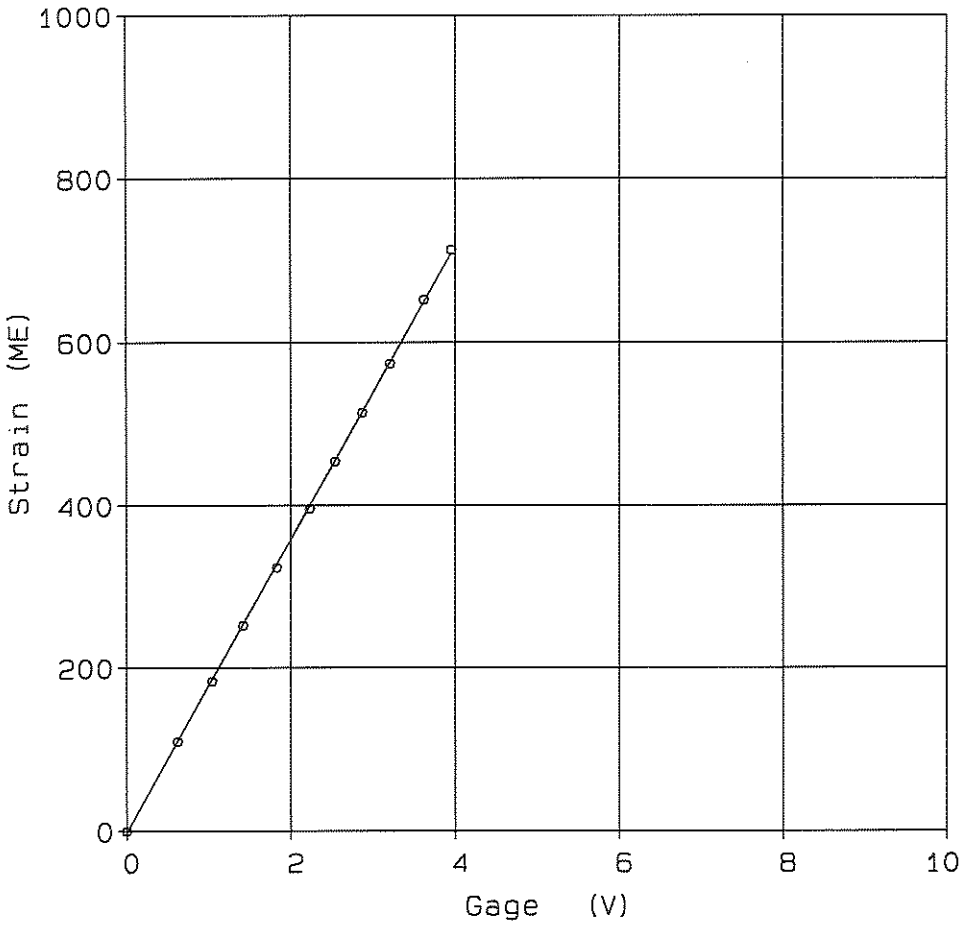

PDA Cal Factor = 180.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 625.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
109	.62
184	1.04
253	1.43
324	1.83
396	2.23
454	2.55
514	2.88
575	3.21
652	3.63
713	3.96

Calibrated by: J. Denkstaff

Calibrated on: 27-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2