Pile Dynamics, Inc.
Transducer 394W

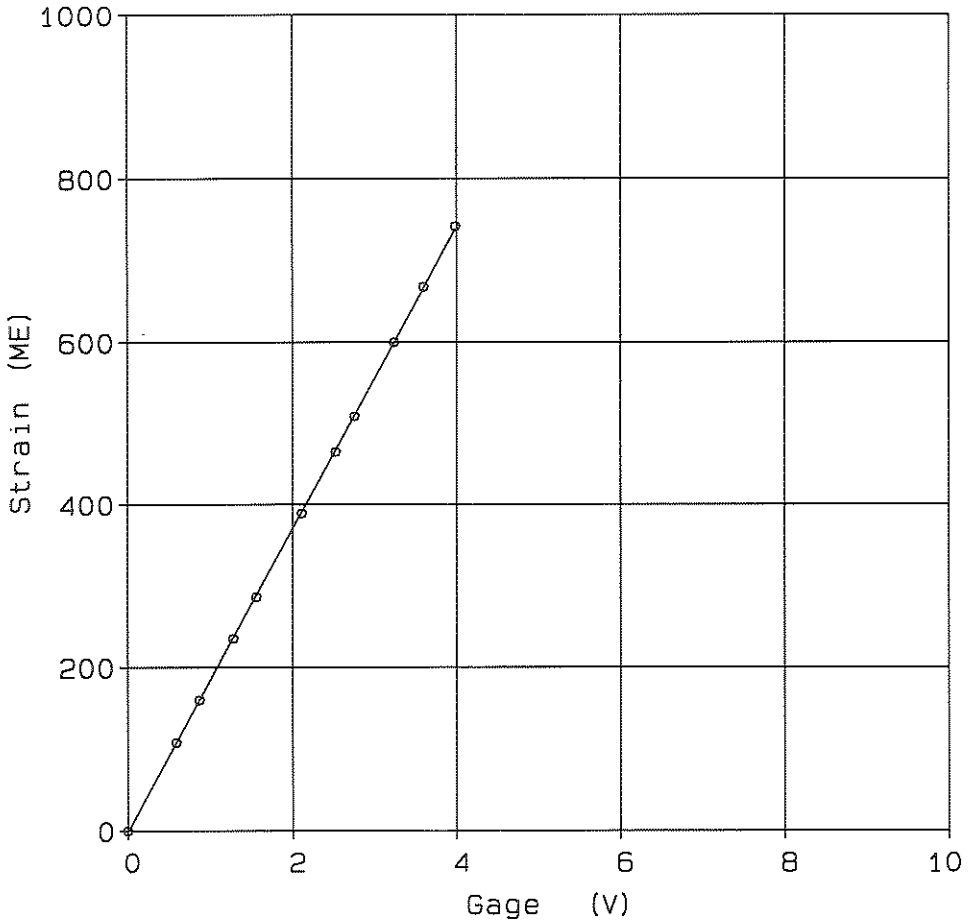

PDA Cal Factor = 186.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 647.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
108	.59
160	.88
236	1.29
286	1.56
389	2.12
465	2.52
509	2.75
600	3.24
669	3.59
742	3.99

Calibrated by: _____

Calibrated on: 27-Aug-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2