Pile Dynamics Inc

Transducer 395W

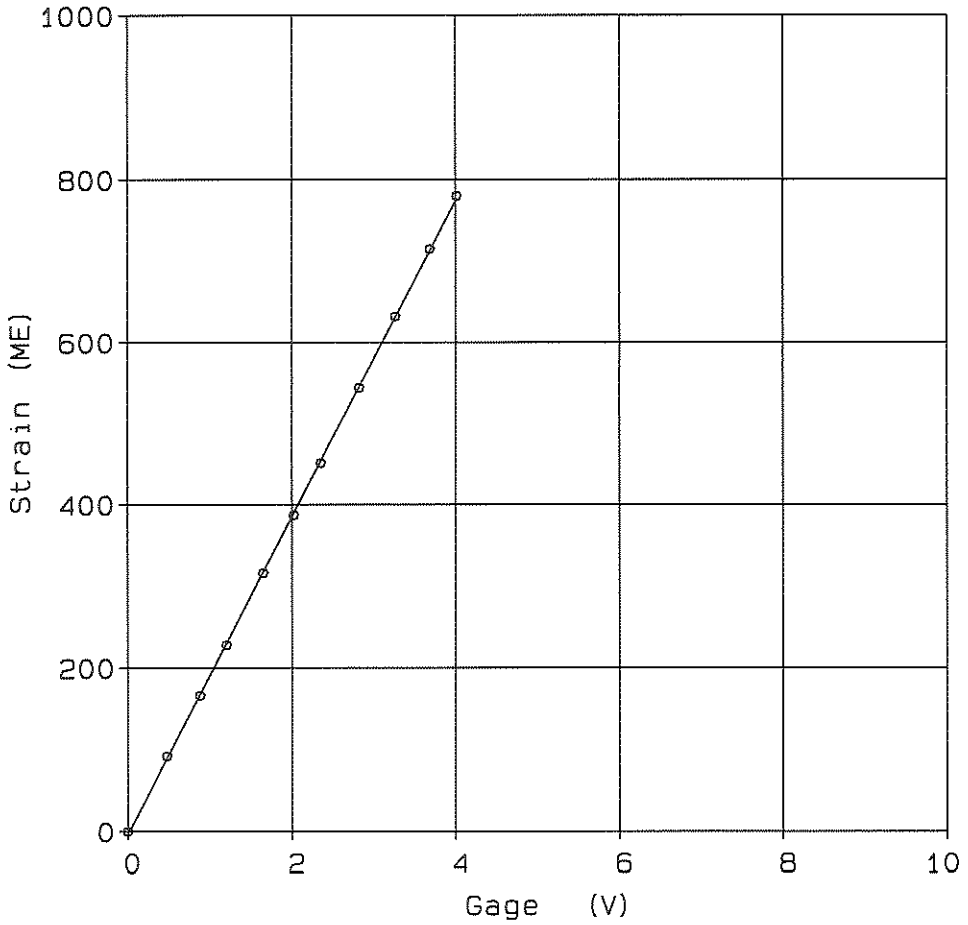

PDA Cal Factor = 194.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 675.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
92	.49
167	.88
228	1.20
316	1.66
387	2.02
452	2.36
545	2.83
633	3.27
716	3.69
780	4.02

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 06-Mar-97

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2