Pile Dynamics, Inc.
Transducer 396W

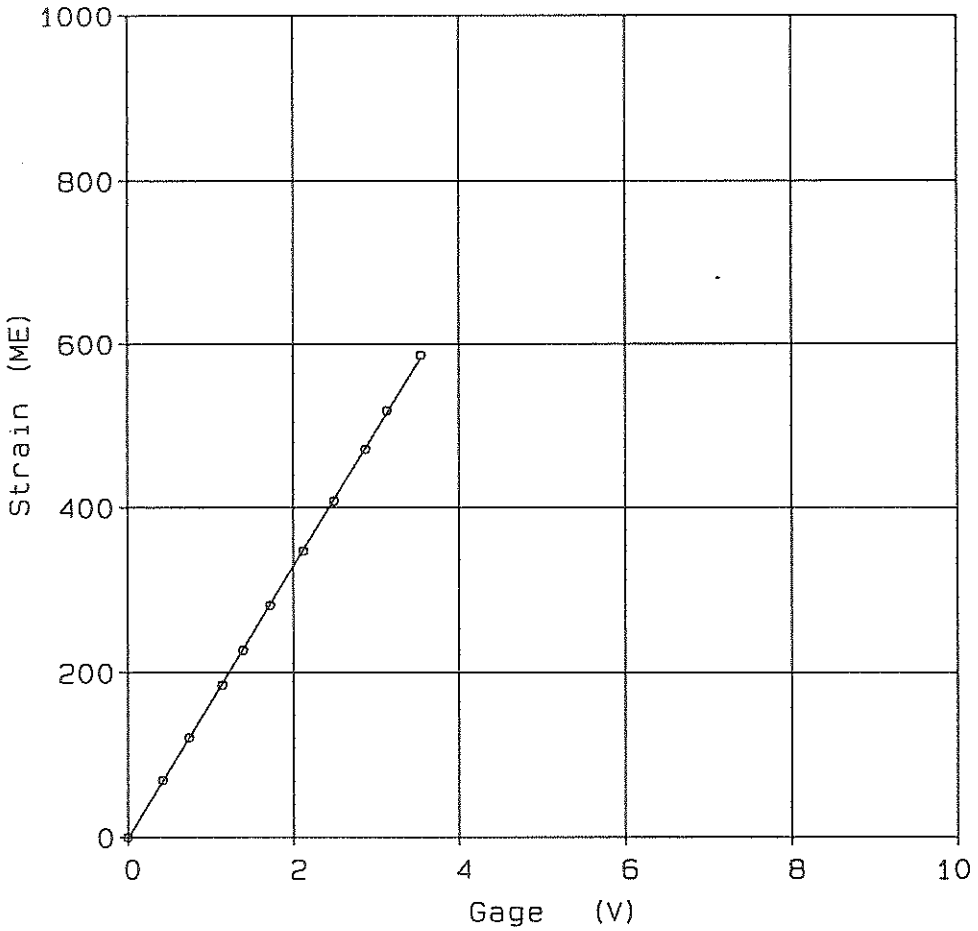

PDA Cal Factor = 165.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 574.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
69	.43
122	.75
185	1.14
227	1.40
281	1.73
347	2.12
408	2.49
472	2.87
518	3.14
586	3.54

Calibrated by: J. Pentzlaff

Calibrated on: 12-Nov-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2