Pile Dynamics, Inc.

Transducer 397W

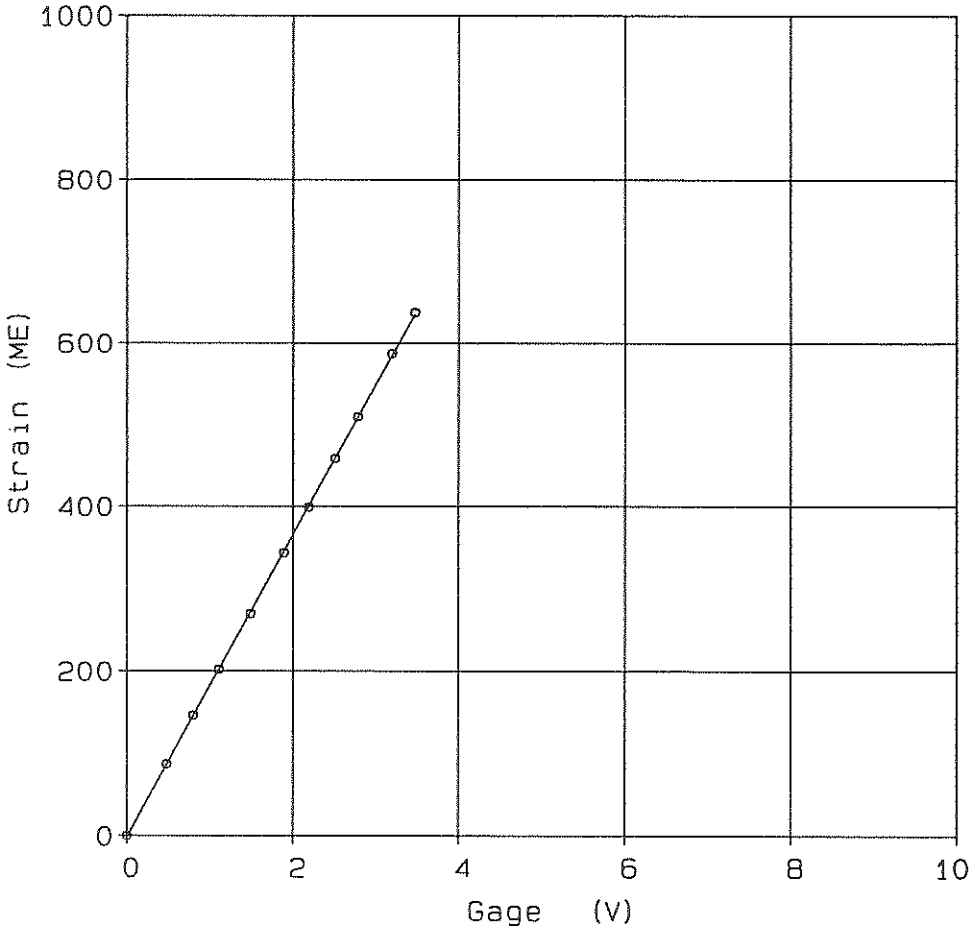

PDA Cal Factor = 184.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 639.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
87	.49
146	.81
202	1.12
270	1.49
344	1.90
399	2.19
459	2.51
511	2.79
587	3.20
639	3.47

Calibrated by: J. Stabdall

Calibrated on: 12-Nov-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2