# Pile Dynamics, Inc.

## Transducer 399W

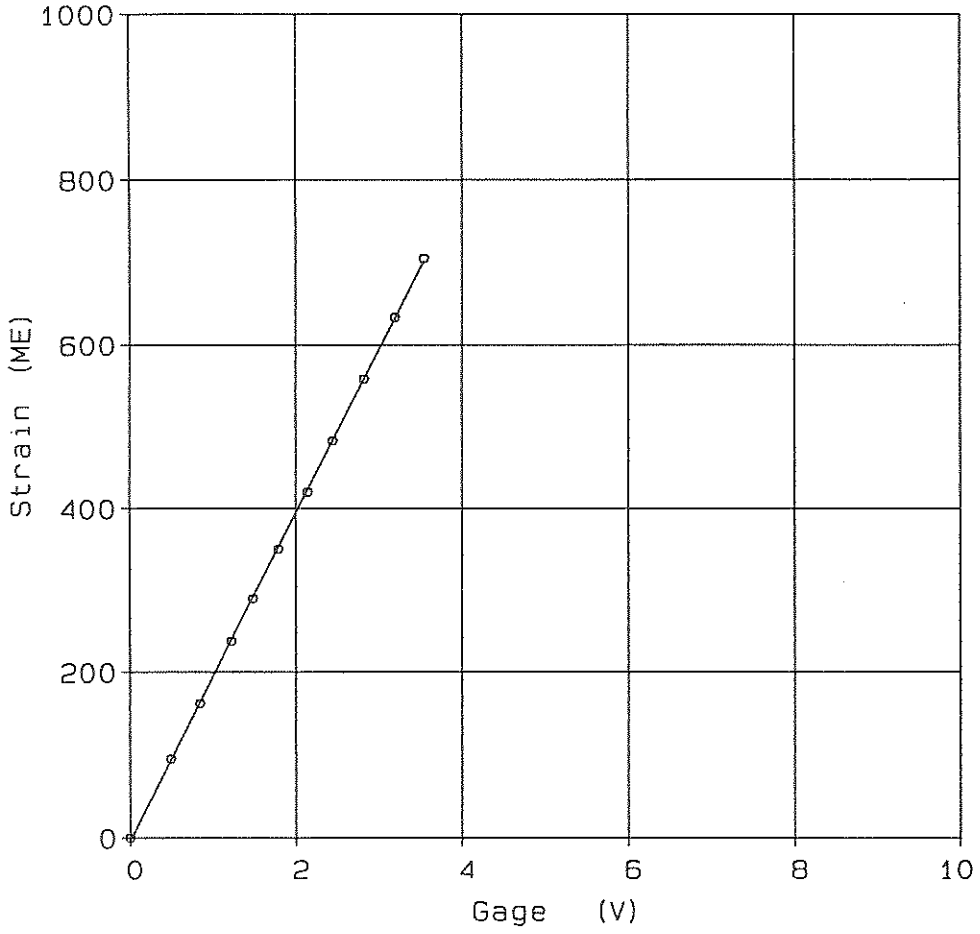


PDA Cal Factor = 199.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 692.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 95 | .50 |
| 163 | .84 |
| 237 | 1.22 |
| 289 | 1.49 |
| 351 | 1.79 |
| 421 | 2.14 |
| 482 | 2.45 |
| 559 | 2.82 |
| 634 | 3.20 |
| 705 | 3.55 |

Calibrated by: J. Rowland

Calibrated on: 12-Nov-96

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2