# Pile Dynamics, Inc.

## Transducer 534C

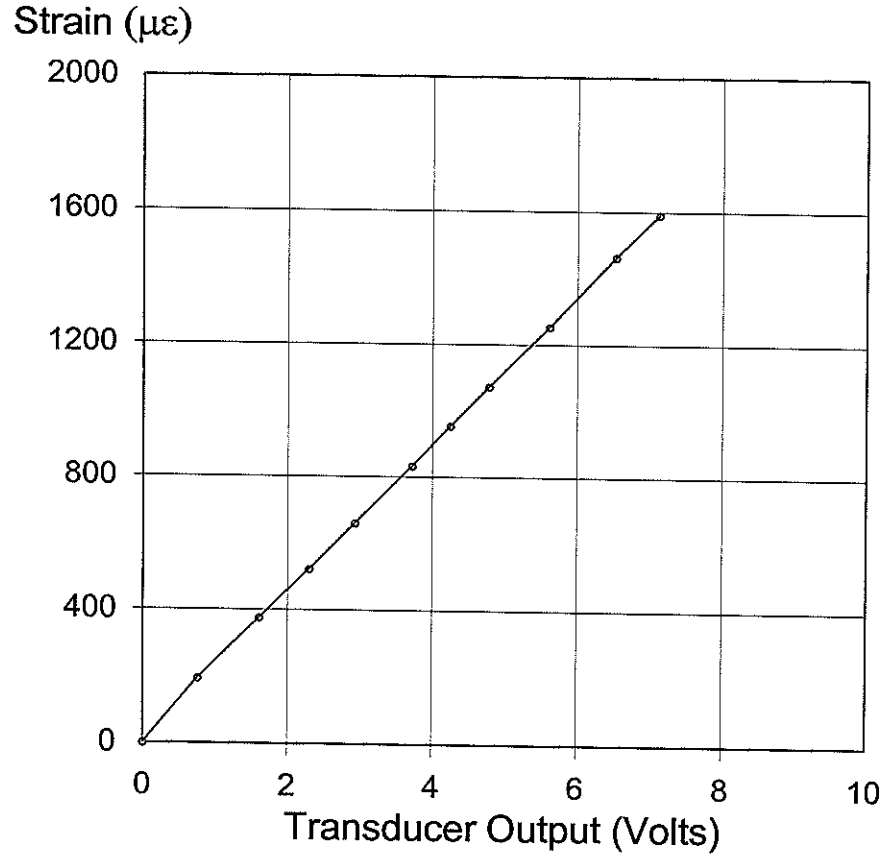


PDA Cal Factor (5.0 V) 110.9με/V

| Applied Strain (με) | Transducer Output (Volts) |
|---|---|
| 0 | 0.00 |
| 193 | 0.75 |
| 375 | 1.61 |
| 521 | 2.30 |
| 659 | 2.92 |
| 833 | 3.71 |
| 954 | 4.24 |
| 1073 | 4.78 |
| 1254 | 5.61 |
| 1464 | 6.53 |
| 1592 | 7.12 |

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 385.1με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 08-May-2009

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2