Pile Dynamics, Inc.

Transducer 536C

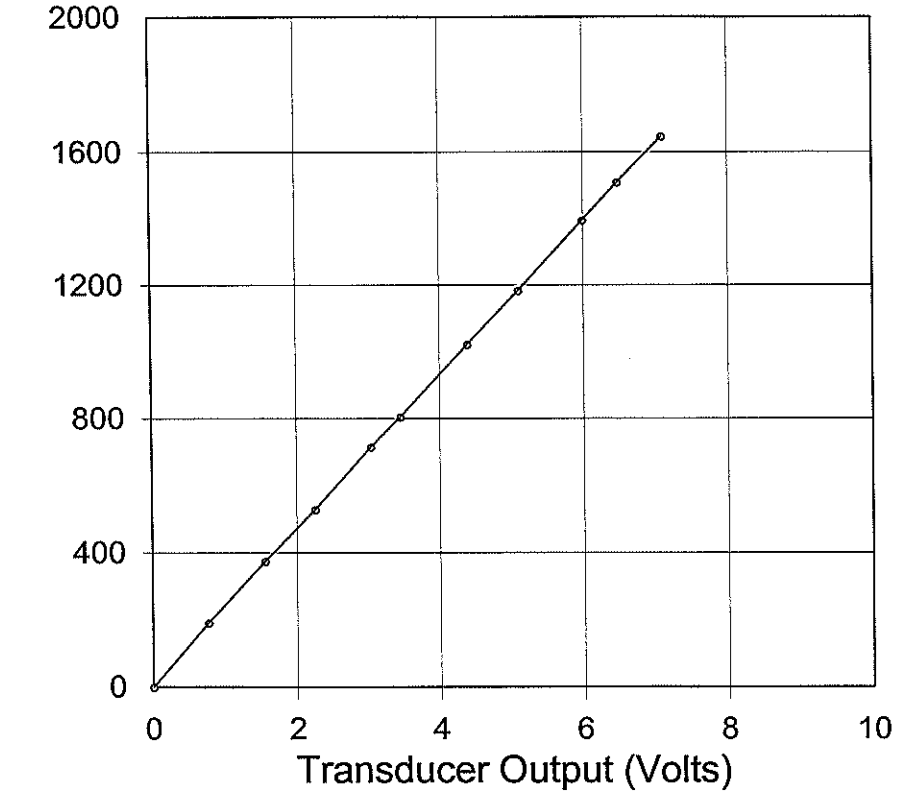

PDA Cal Factor (5.0 V) 115.6με/V

Applied Strain (με)	Transducer Output (Volts)
0	0.00
191	0.76
373	1.56
528	2.25
712	3.03
805	3.44
1021	4.38
1183	5.09
1395	5.99
1510	6.48
1646	7.09

Shunt (60.4 KΩ) 2.5 V

General Factor 401.5με/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Calibrated by:

Calibrated on: 06-May-2008

Strain Transducer Calibrator System 2004 Version 1.2