
PILE DYNAMICS, INC.

4/14/86 CAL GAGE NO. 592 C

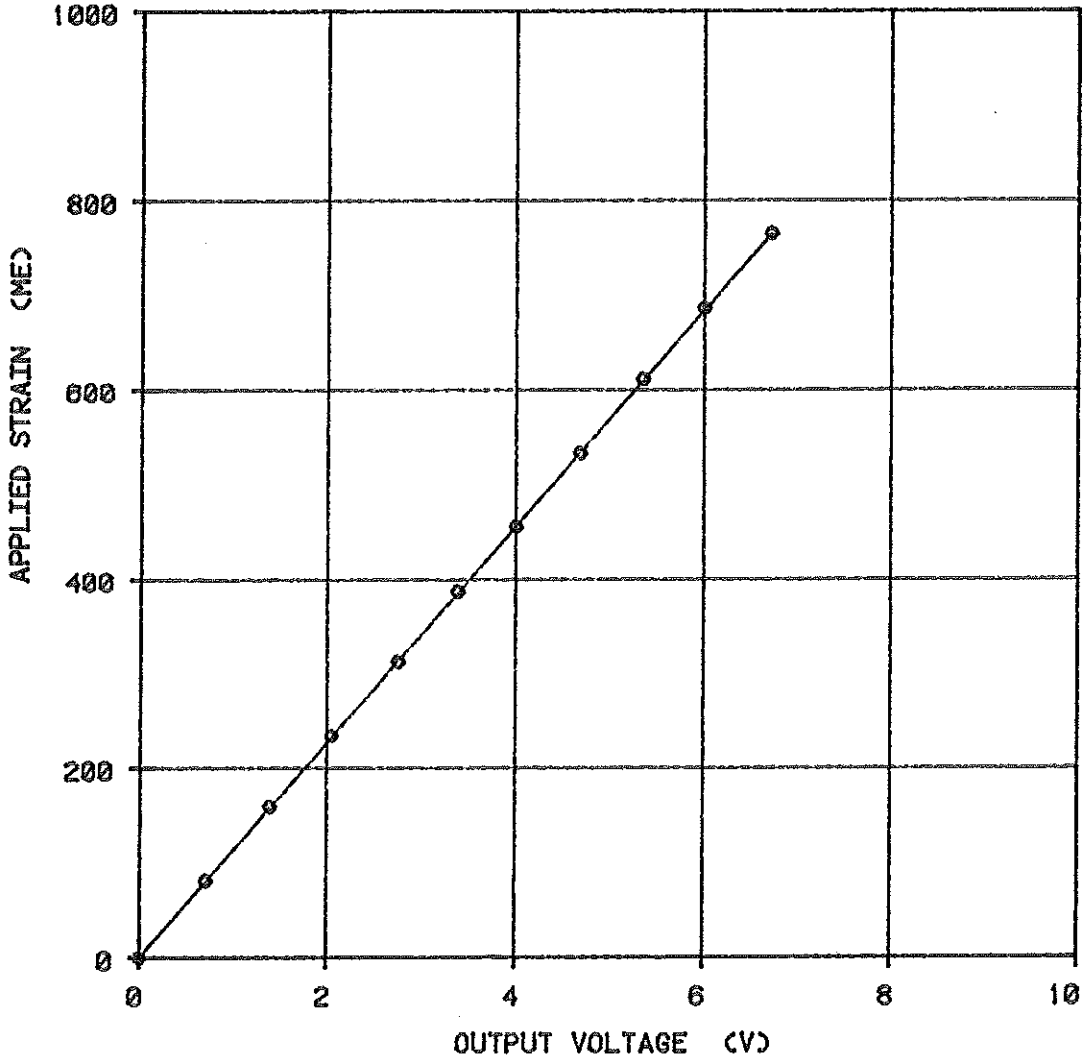

INIT

4/14/86 CAL
GAGE NO. 592C

NO.	APPLD. STRAIN ME	GAGE VOLTAGE V
1	0.000	0.000
2	81.210	0.712
3	159.128	1.394
4	234.555	2.040
5	312.232	2.753
6	386.022	3.386
7	455.646	4.002
8	533.211	4.689
9	611.372	5.354
10	686.464	6.008
11	765.256	6.712

GAGE CALIBRATION FACTOR= 114.101 ME/V

GAGE REF. SHUNT (60.4KΩ)= 5.000 VOLTS

OFFSET = 0.0769 CORRELATION COEFFICIENT = 1.0000

VALUES ARE AVERAGED