Pile Dynamics Inc
Transducer 600W

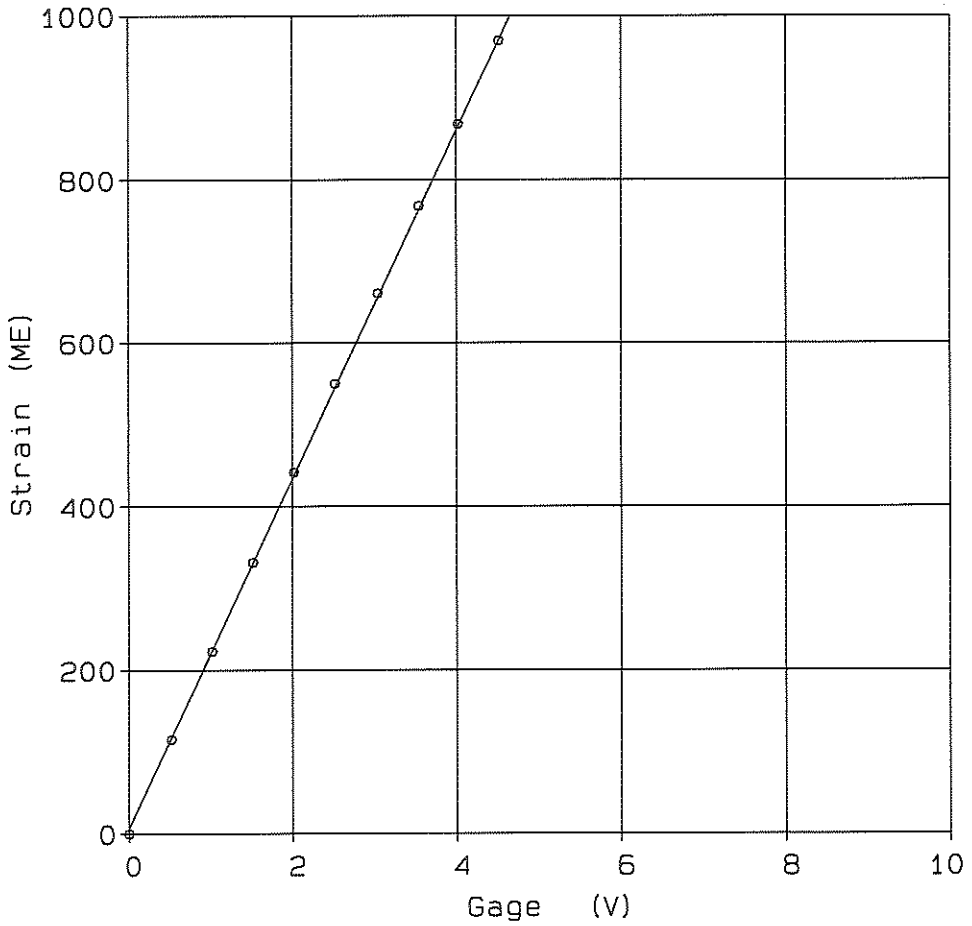

PDA Cal Factor = 213.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 741.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
115	.53
224	1.02
333	1.52
443	2.02
551	2.52
661	3.04
769	3.55
869	4.02
970	4.51
1064	5.01

Calibrated by: Fred Haskin

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2