Pile Dynamics Inc
Transducer 602W

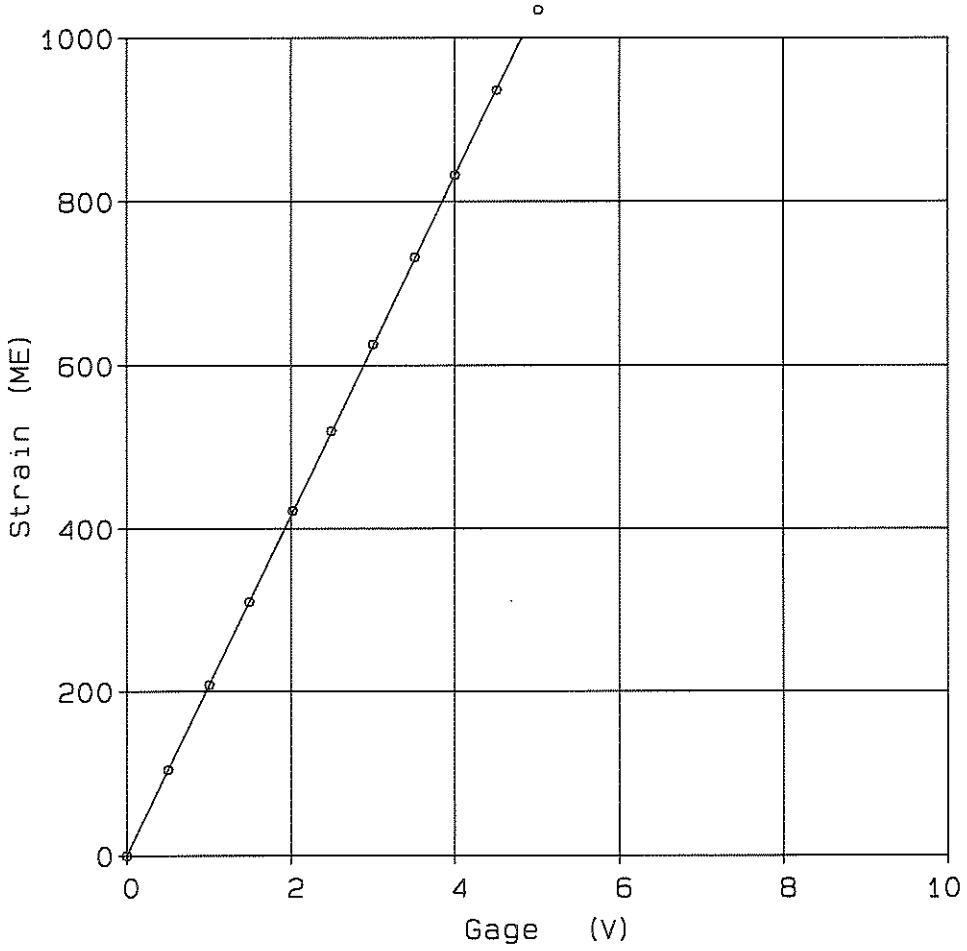

PDA Cal Factor = 207.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 720.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
104	.51
208	1.01
310	1.50
423	2.02
521	2.49
627	3.01
732	3.51
833	4.00
937	4.51
1035	5.01

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2