Pile Dynamics Inc
Transducer 603W

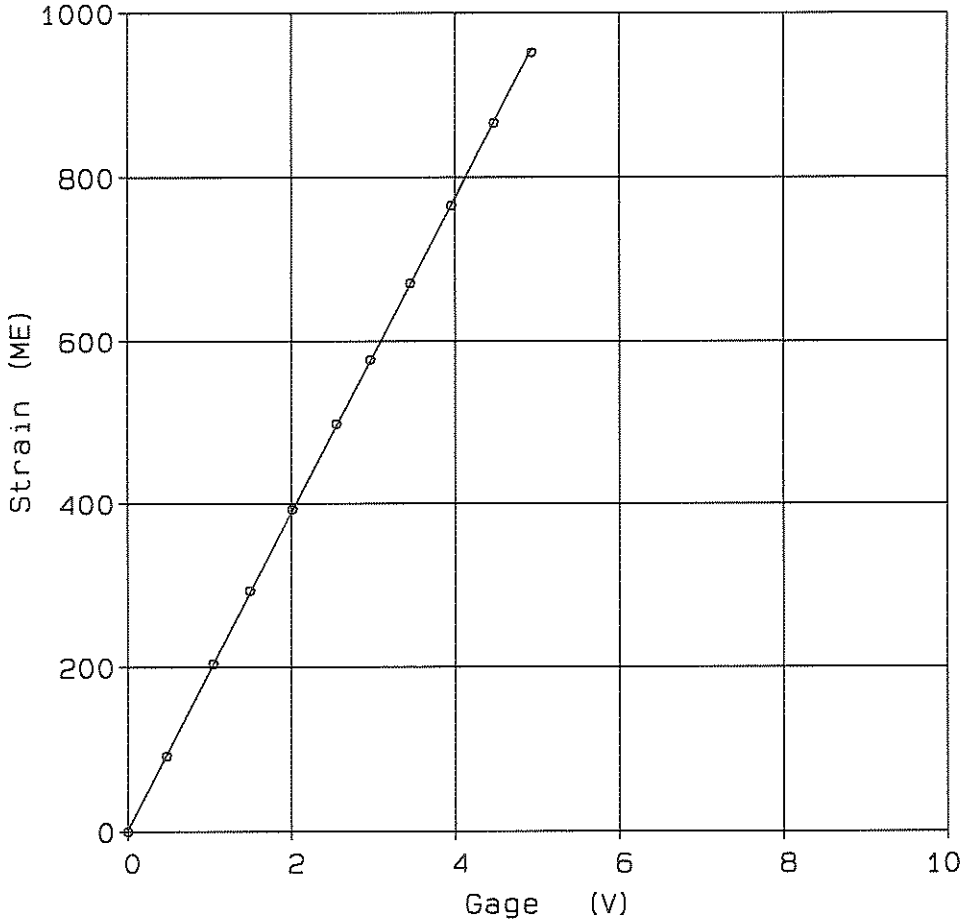

PDA Cal Factor = 193.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 670.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.47
204	1.04
293	1.50
393	2.01
498	2.55
577	2.96
672	3.45
767	3.95
867	4.48
953	4.94

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2