Pile Dynamics Inc
Transducer 604W

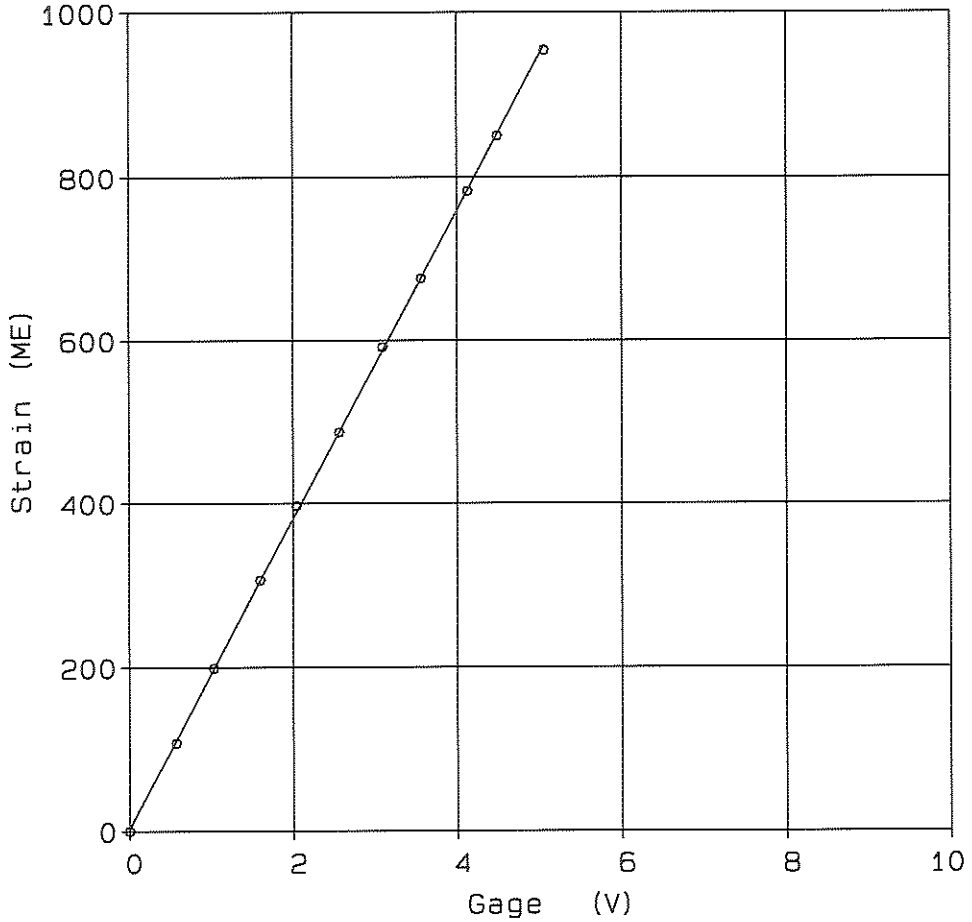

PDA Cal Factor = 188.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 655.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
109	.58
199	1.03
307	1.60
398	2.05
488	2.56
593	3.10
676	3.57
783	4.13
851	4.49
955	5.07

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03