Pile Dynamics Inc
Transducer 605W

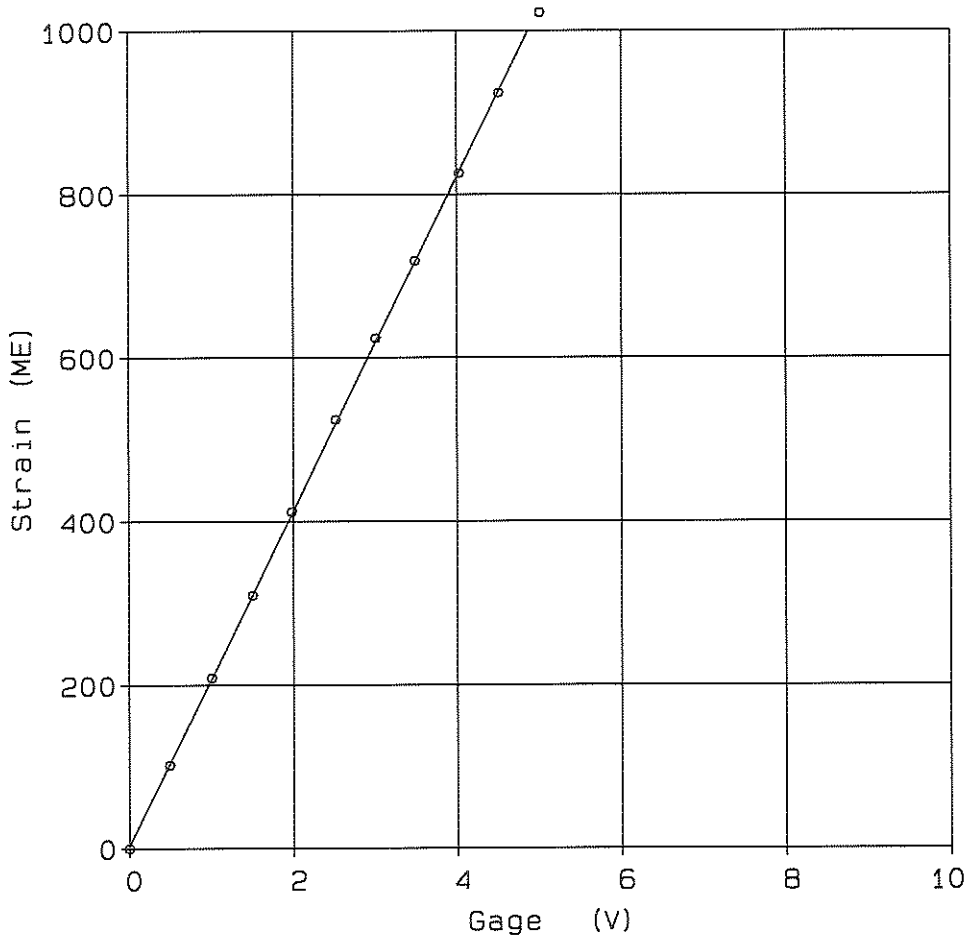

PDA Cal Factor = 204.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 709.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
102	.49
209	1.01
311	1.50
413	1.99
524	2.53
624	3.02
719	3.49
827	4.03
925	4.51
1022	5.01

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2