Pile Dynamics Inc
Transducer 606W

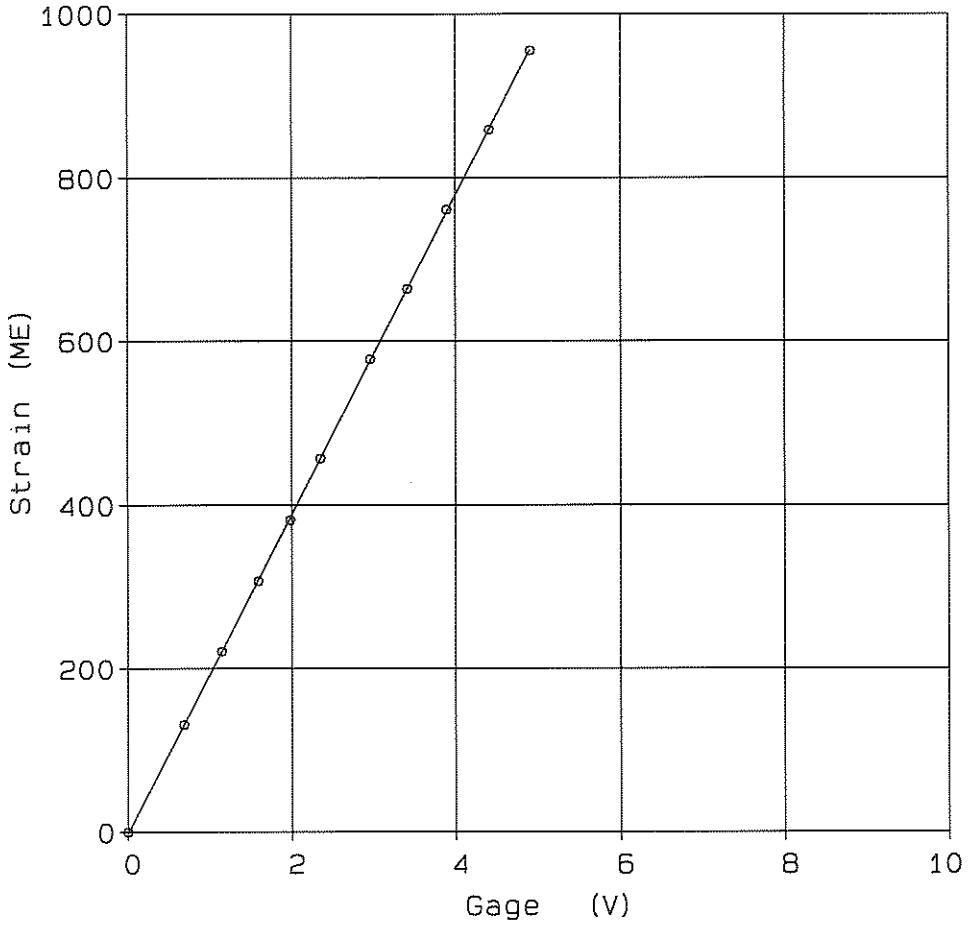

PDA Cal Factor = 195.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 678.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
131	.69
222	1.15
307	1.59
382	1.98
458	2.35
579	2.97
665	3.41
762	3.90
860	4.41
956	4.92

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 02-Feb-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2