Pile Dynamics Inc
Transducer 607W

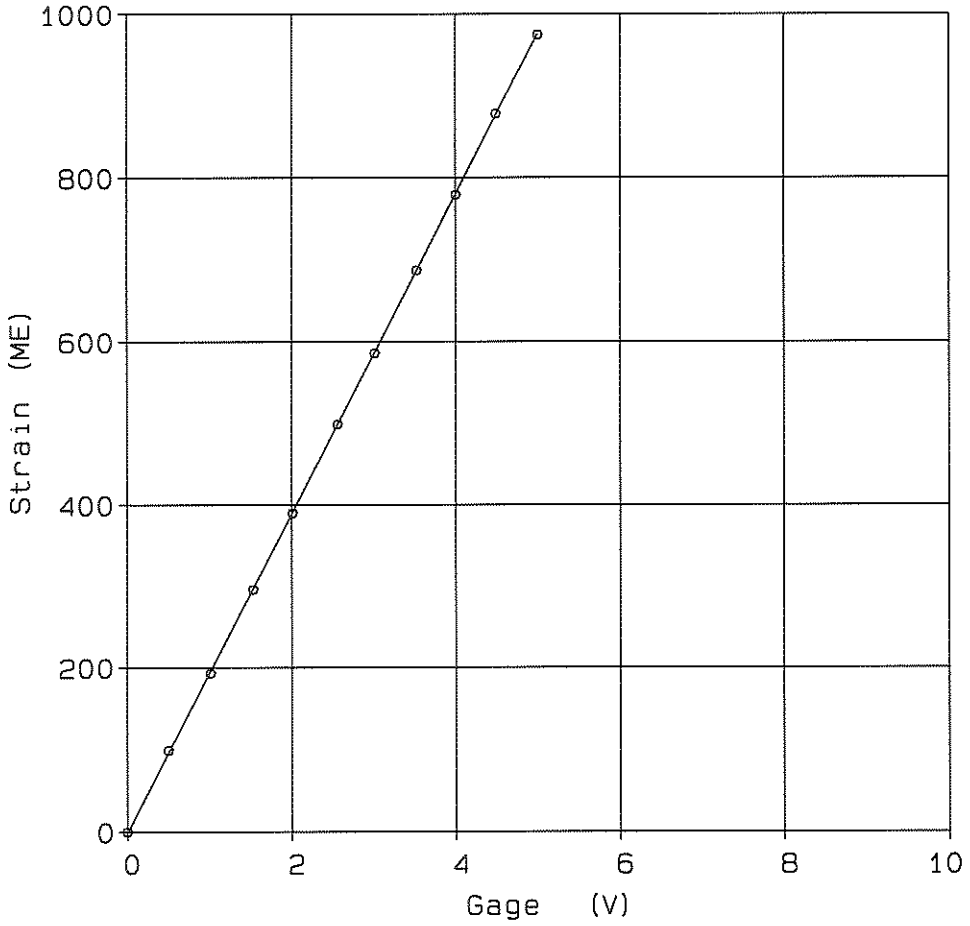

PDA Cal Factor = 195.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 678.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
99	.51
194	1.02
296	1.54
390	2.02
499	2.56
586	3.01
688	3.52
780	4.00
879	4.50
975	5.00

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2