Pile Dynamics Inc
Transducer 608W

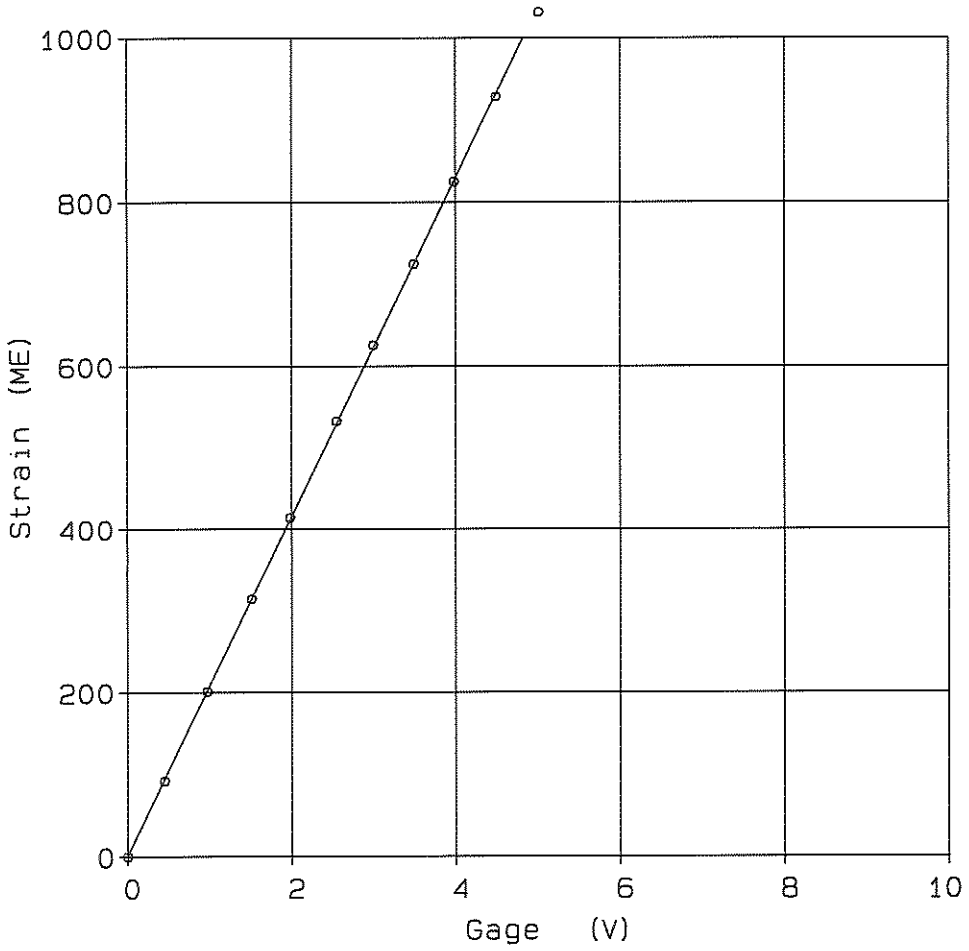

PDA Cal Factor = 206.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 717.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
93	.46
202	.97
315	1.51
415	1.99
533	2.55
627	3.00
726	3.49
826	3.98
929	4.50
1033	5.01

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2