Pile Dynamics Inc
Transducer 609W

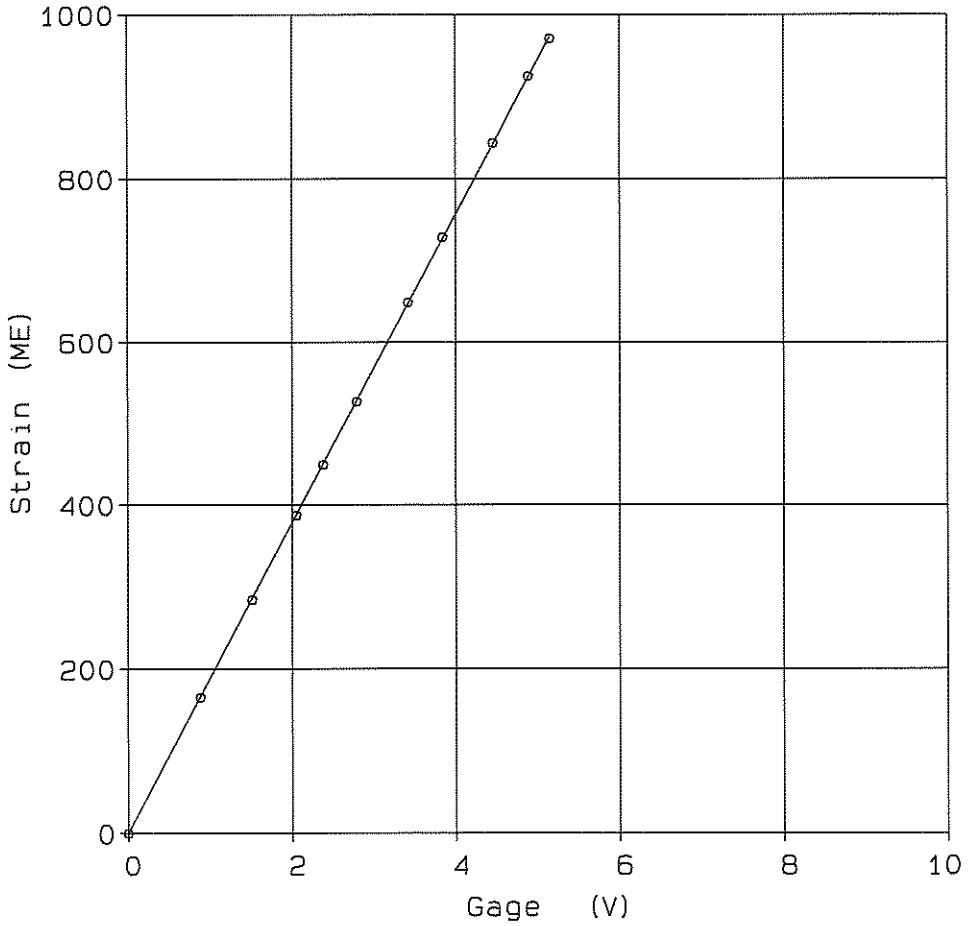

PDA Cal Factor = 189.6 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 658.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
165	.88
285	1.51
387	2.05
449	2.38
527	2.79
649	3.42
729	3.84
844	4.45
925	4.89
971	5.14

Calibrated by: J. Dewitchuff

Calibrated on: 10-Feb-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2