Pile Dynamics Inc
Transducer 610W

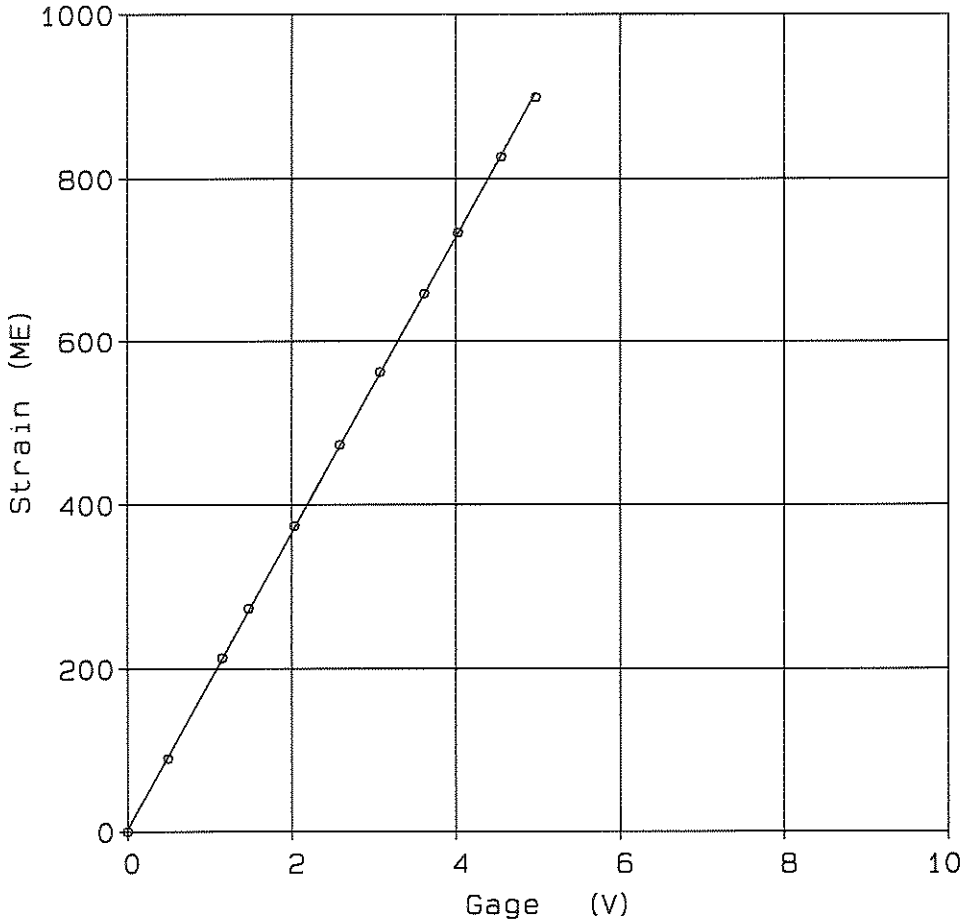

PDA Cal Factor = 181.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 628.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
91	.50
214	1.15
274	1.48
375	2.04
473	2.58
563	3.07
660	3.61
735	4.03
827	4.56
899	4.98

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 11-Apr-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2