Pile Dynamics Inc
Transducer 611W

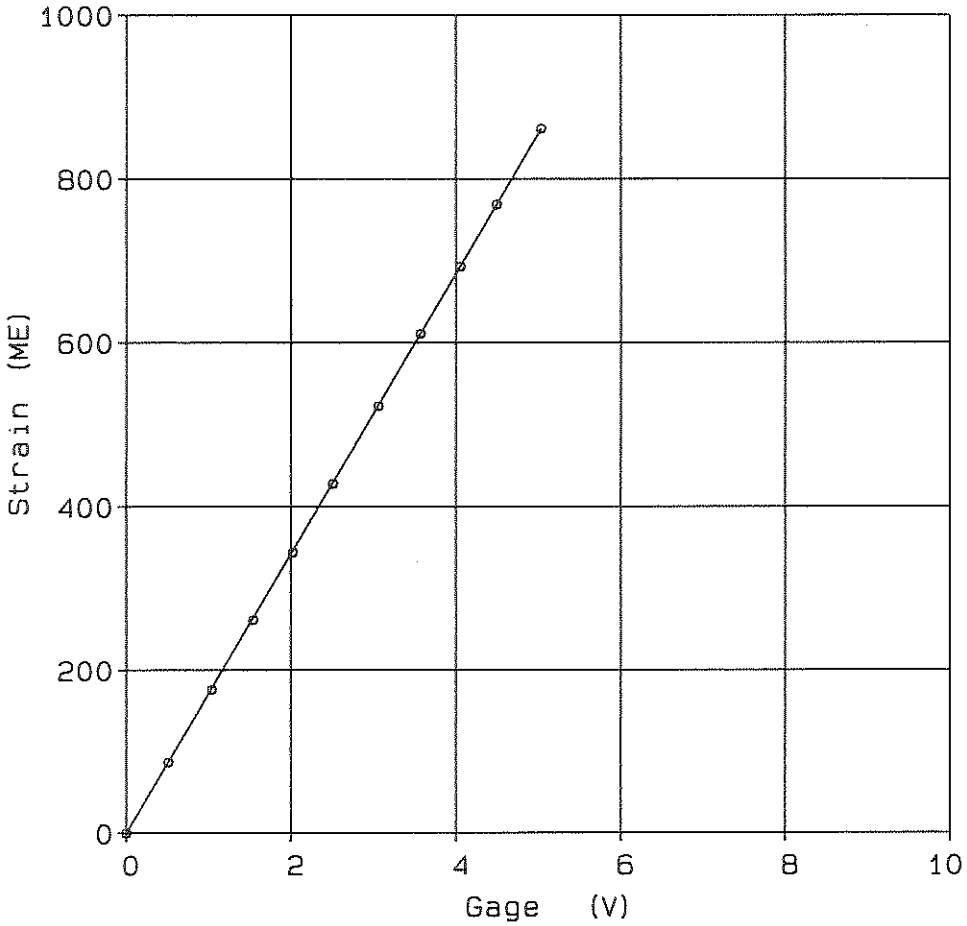

PDA Cal Factor = 171.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 595.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
88	.52
176	1.04
261	1.54
344	2.02
429	2.51
524	3.06
612	3.57
693	4.05
770	4.49
861	5.04

Calibrated by: J. Daulf

Calibrated on: 12-May-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2