# Pile Dynamics Inc

## Transducer 612W

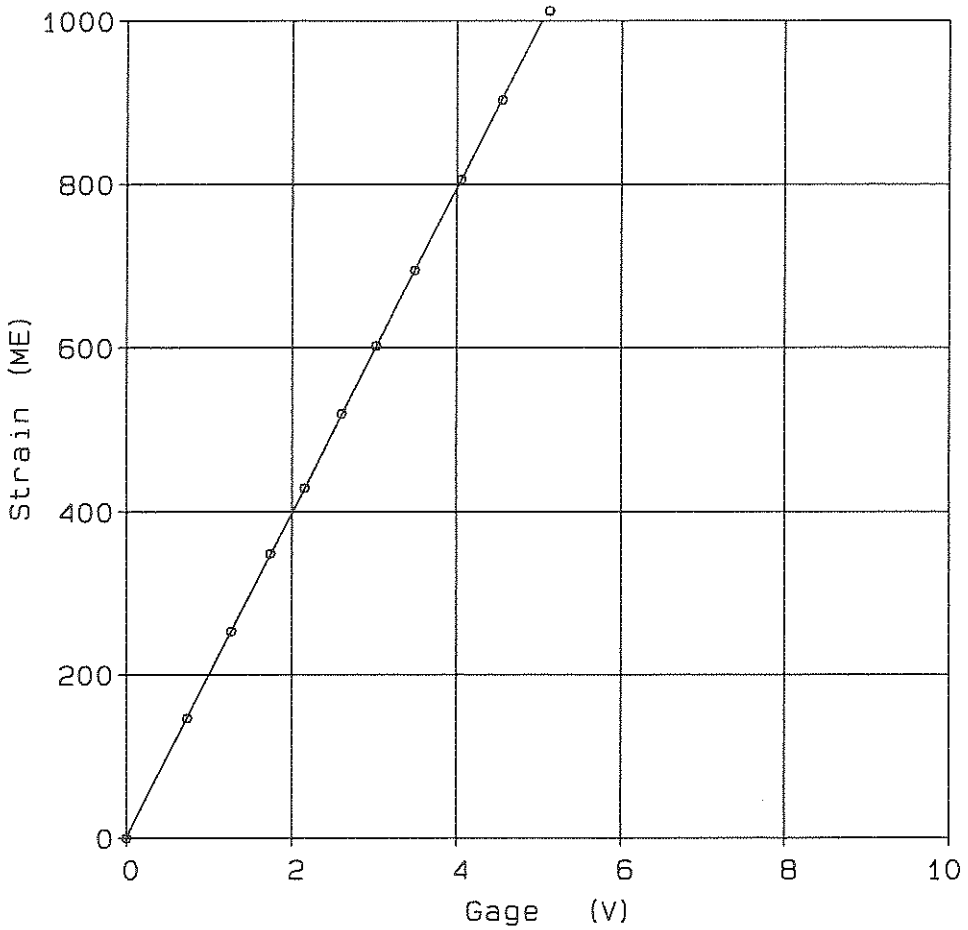


PDA Cal Factor = 198.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 688.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 147 | .74 |
| 254 | 1.28 |
| 348 | 1.75 |
| 430 | 2.16 |
| 519 | 2.61 |
| 603 | 3.03 |
| 695 | 3.49 |
| 807 | 4.06 |
| 903 | 4.56 |
| 1012 | 5.12 |

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 31-Dec-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2