Pile Dynamics Inc
Transducer 613W

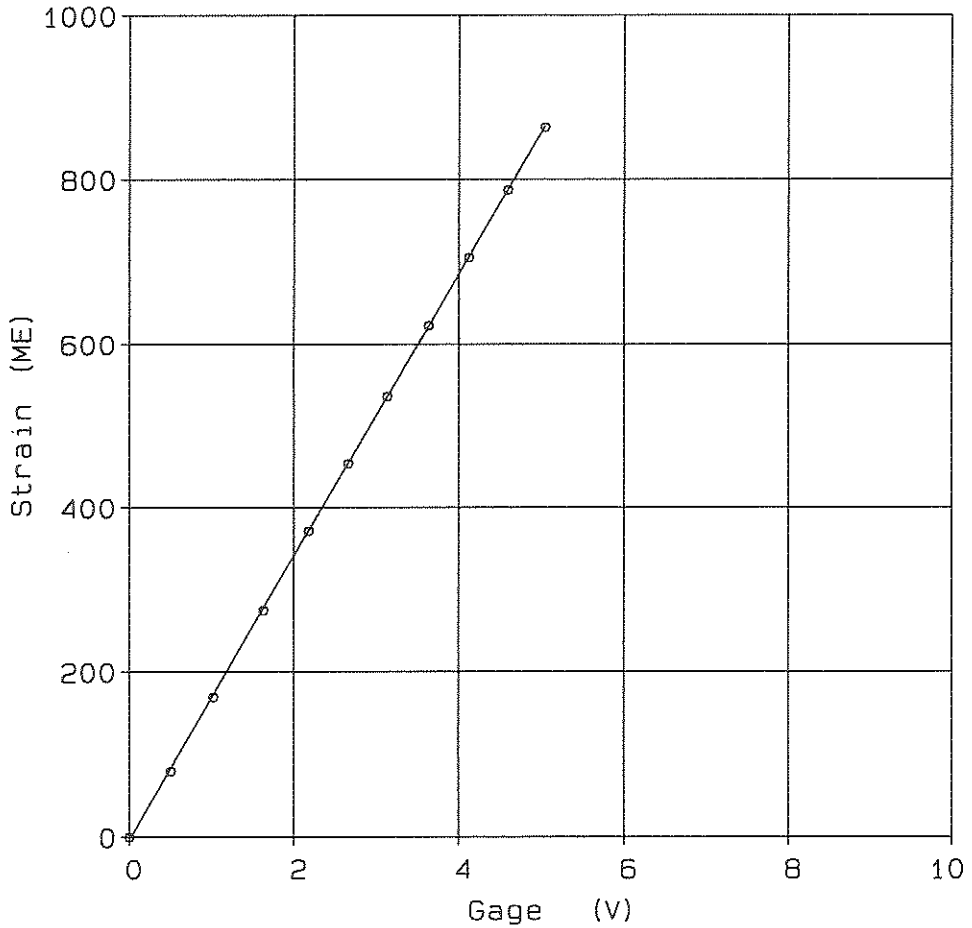

PDA Cal Factor = 172.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 598.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
79	.50
170	1.03
275	1.63
371	2.18
454	2.66
536	3.13
623	3.64
706	4.12
787	4.59
864	5.05

Calibrated by: J. Rautchoff

Calibrated on: 31-Dec-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2