
Pile Dynamics Inc

Transducer 616W

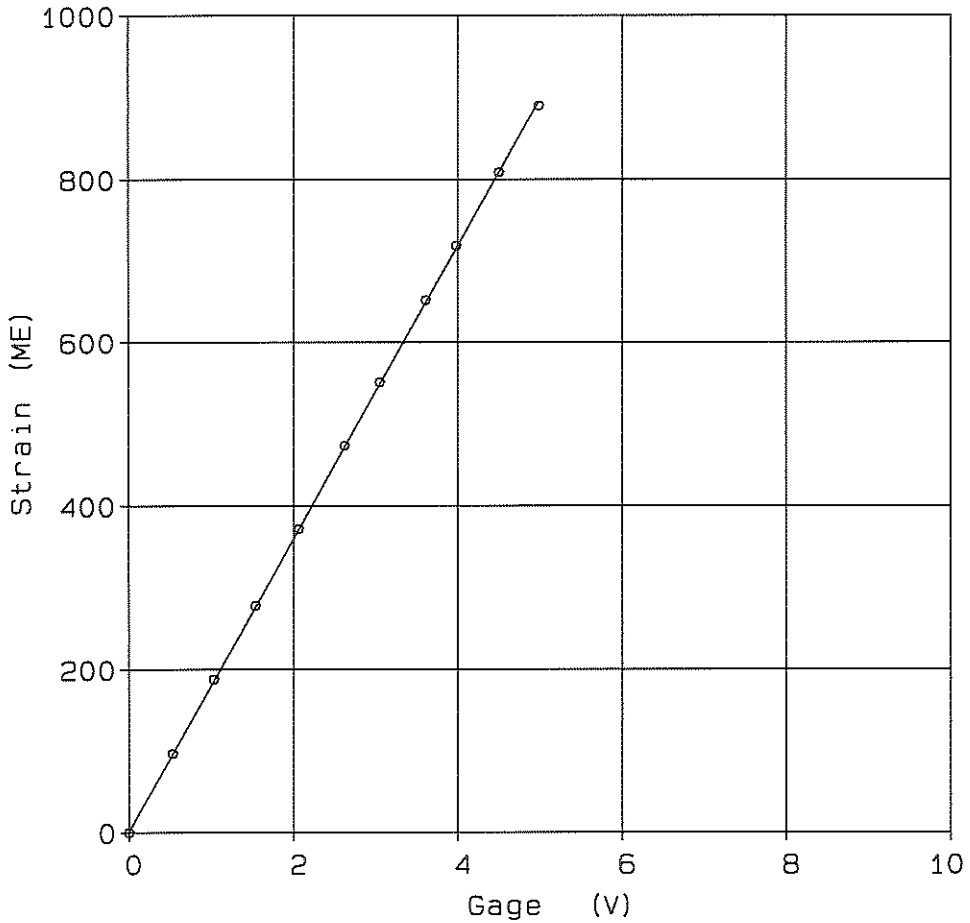

PDA Cal Factor = 179.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 622.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
97	.54
189	1.04
278	1.54
373	2.07
474	2.63
551	3.05
652	3.61
719	3.99
810	4.51
890	4.98

Calibrated by: Fred Hussein

Calibrated on: 09-Sep-03

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2