
Pile Dynamics Inc

Transducer 625W

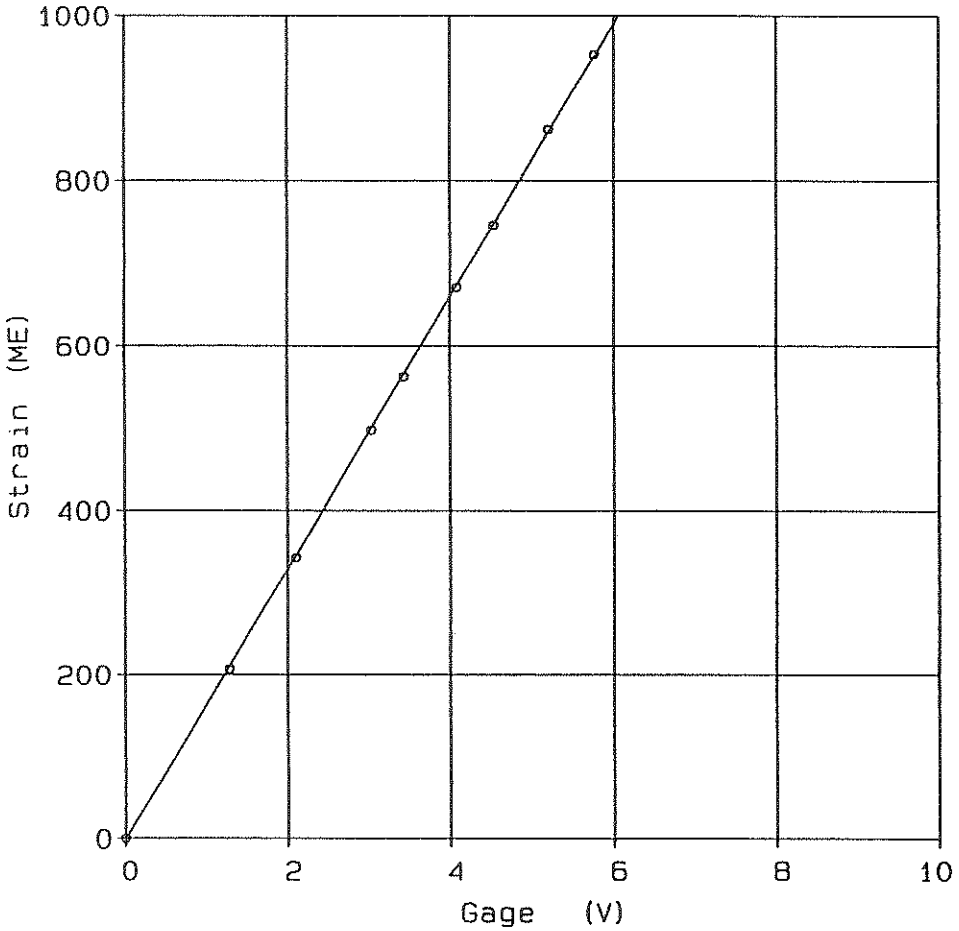

PDA Cal Factor	=	165.4 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	574.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
208	1.28
343	2.11
496	3.03
563	3.44
671	4.08
747	4.54
861	5.21
954	5.76
1064	6.44
1146	6.97

Calibrated by: J. Rowtchoff

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2