
Pile Dynamics Inc

Transducer 626W

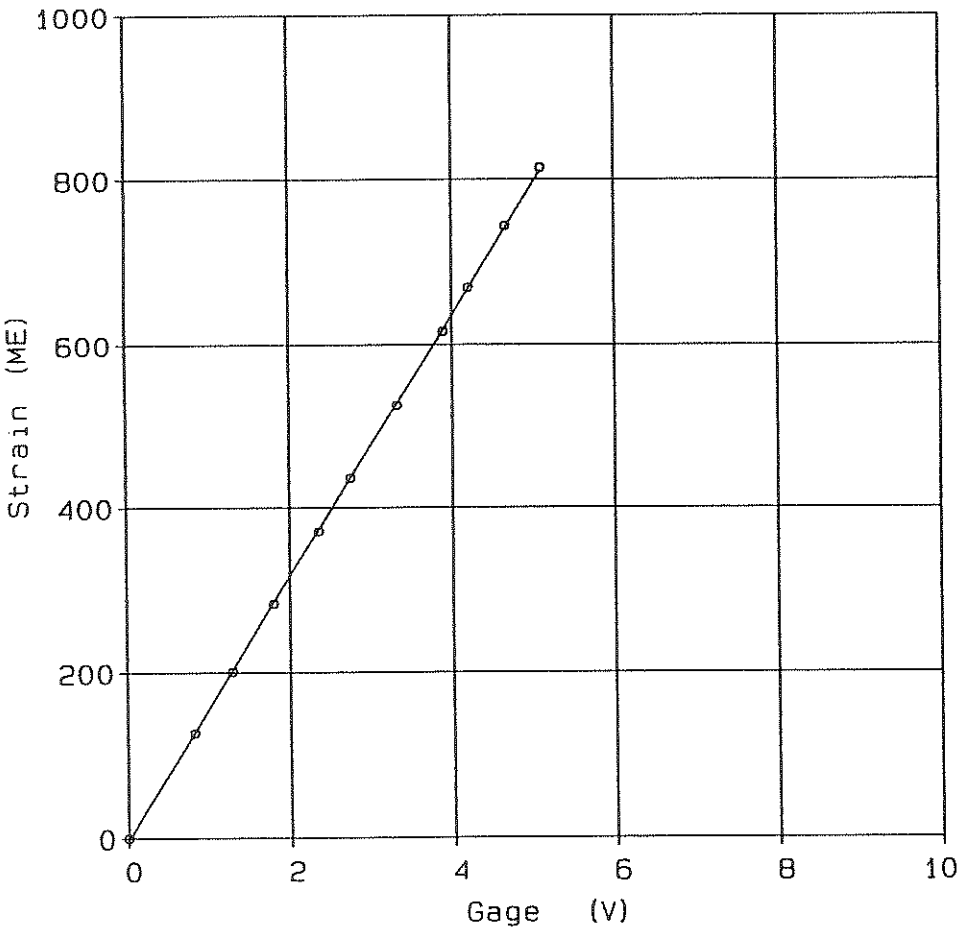

PDA Cal Factor = 159.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 555.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
128	.82
202	1.30
283	1.80
371	2.36
435	2.76
525	3.33
617	3.89
669	4.21
744	4.67
815	5.10

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2