
Pile Dynamics Inc

Transducer 628W

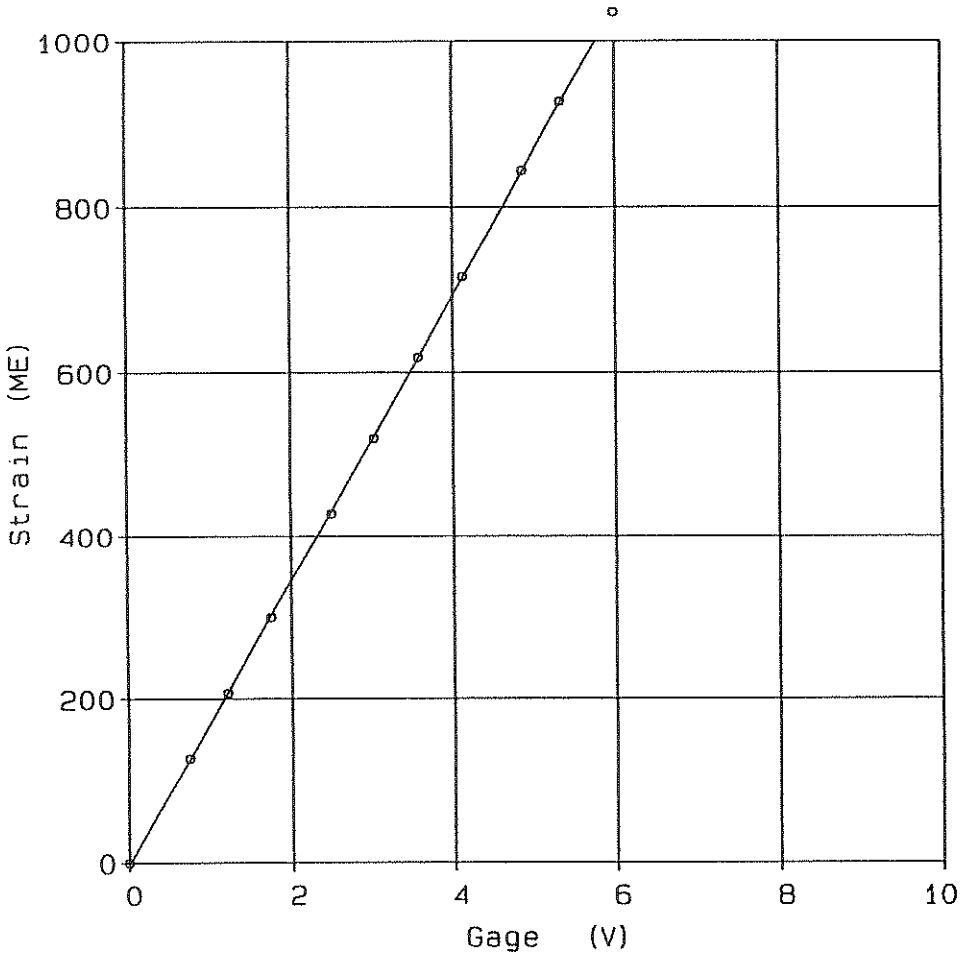

PDA Cal Factor = 173.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 603.5 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
127	.75
208	1.22
298	1.75
428	2.51
520	3.03
619	3.57
716	4.13
844	4.86
925	5.33
1037	6.00

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2