
Pile Dynamics Inc

Transducer 629W

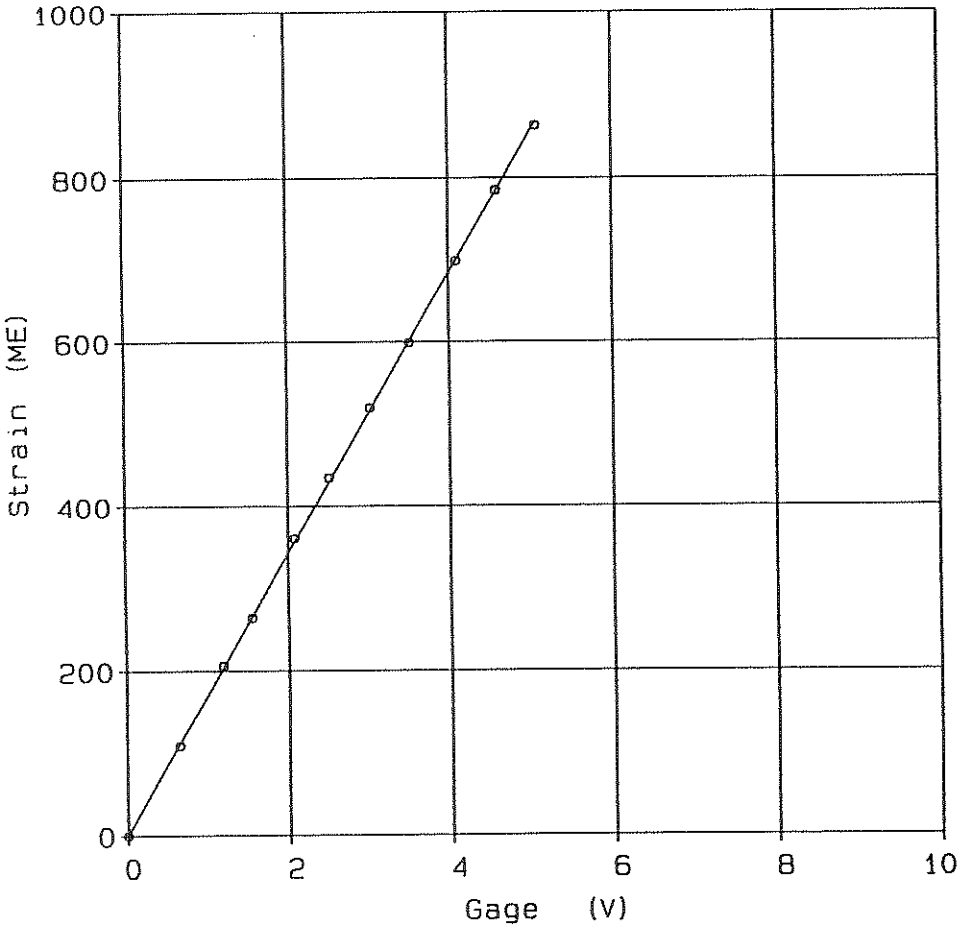

PDA Cal Factor = 170.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 593.2 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
108	.66
206	1.20
264	1.55
360	2.08
436	2.51
520	3.02
600	3.52
699	4.09
786	4.59
864	5.08

Calibrated by: J. Deutschlf

Calibrated on: 04-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2