
Pile Dynamics Inc

Transducer 633W

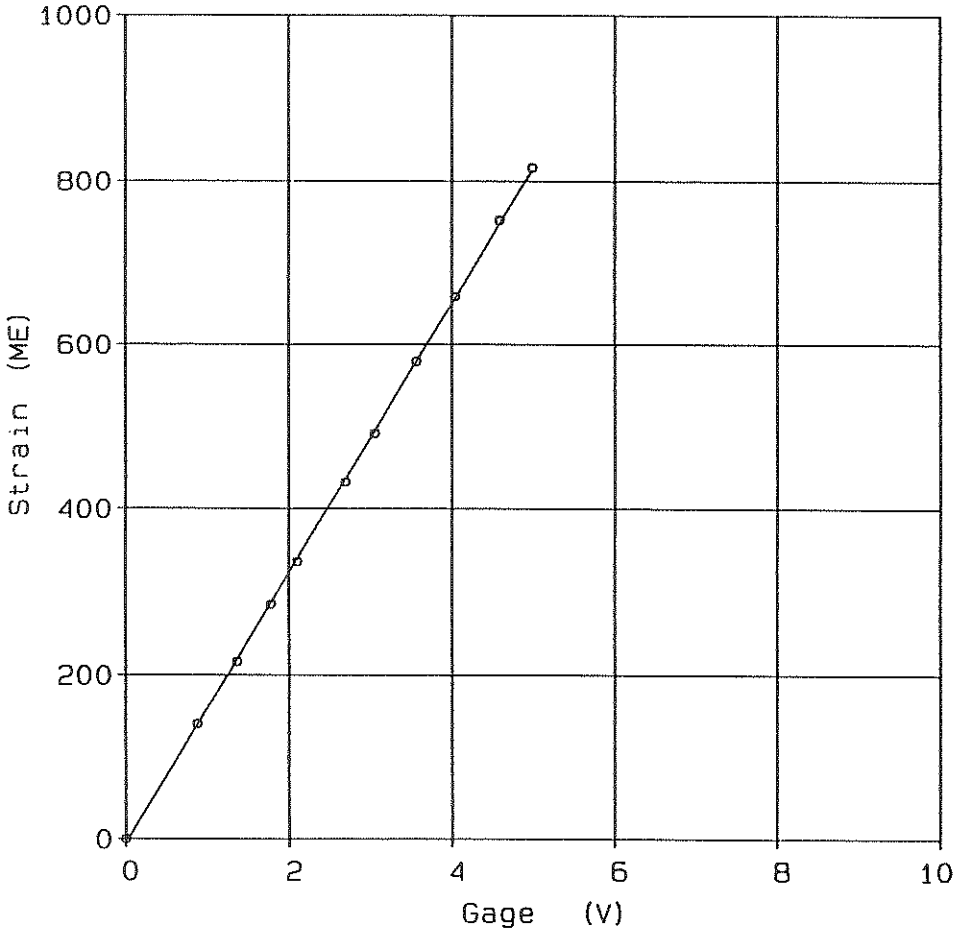

PDA Cal Factor = 164.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 570.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
141	.88
217	1.36
285	1.79
337	2.11
434	2.70
493	3.05
579	3.57
661	4.05
752	4.60
817	4.99

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2