
Pile Dynamics Inc

Transducer 643W

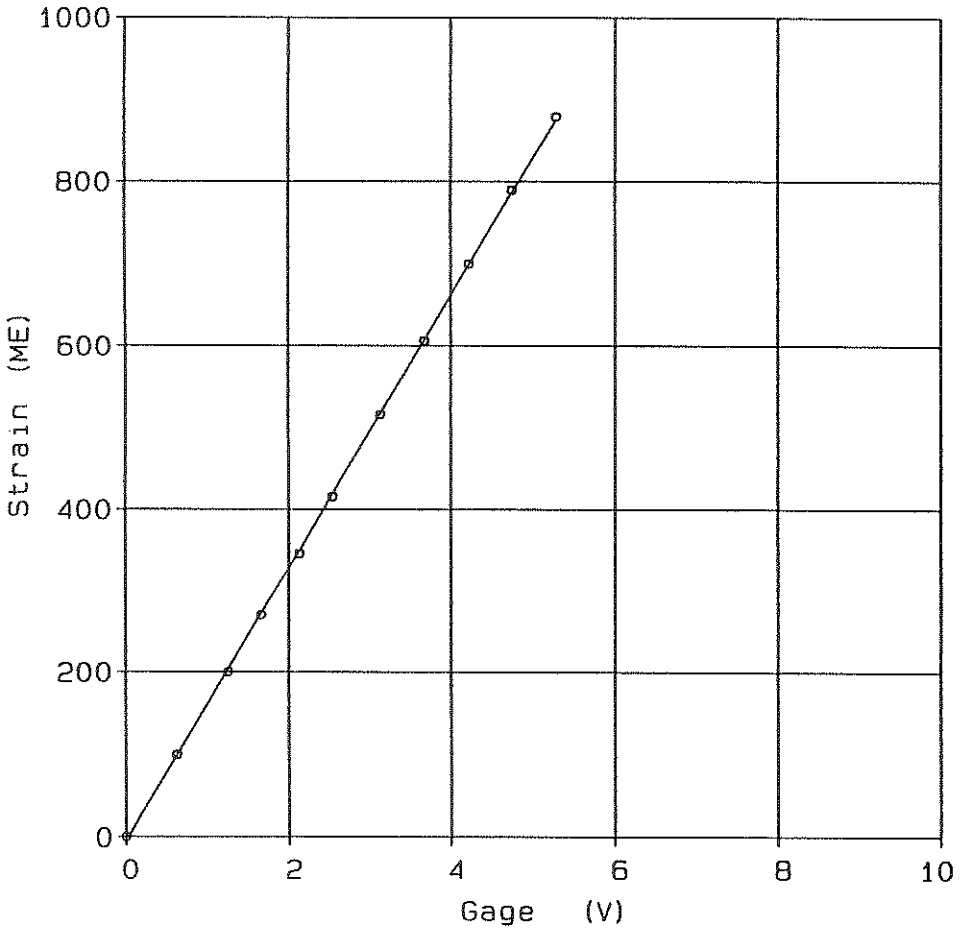

PDA Cal Factor = 167.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 579.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
100	.63
201	1.25
270	1.67
347	2.14
416	2.55
515	3.14
606	3.67
700	4.23
789	4.76
880	5.28

Calibrated by: J. Rietdijk

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2