
Pile Dynamics Inc

Transducer 646W

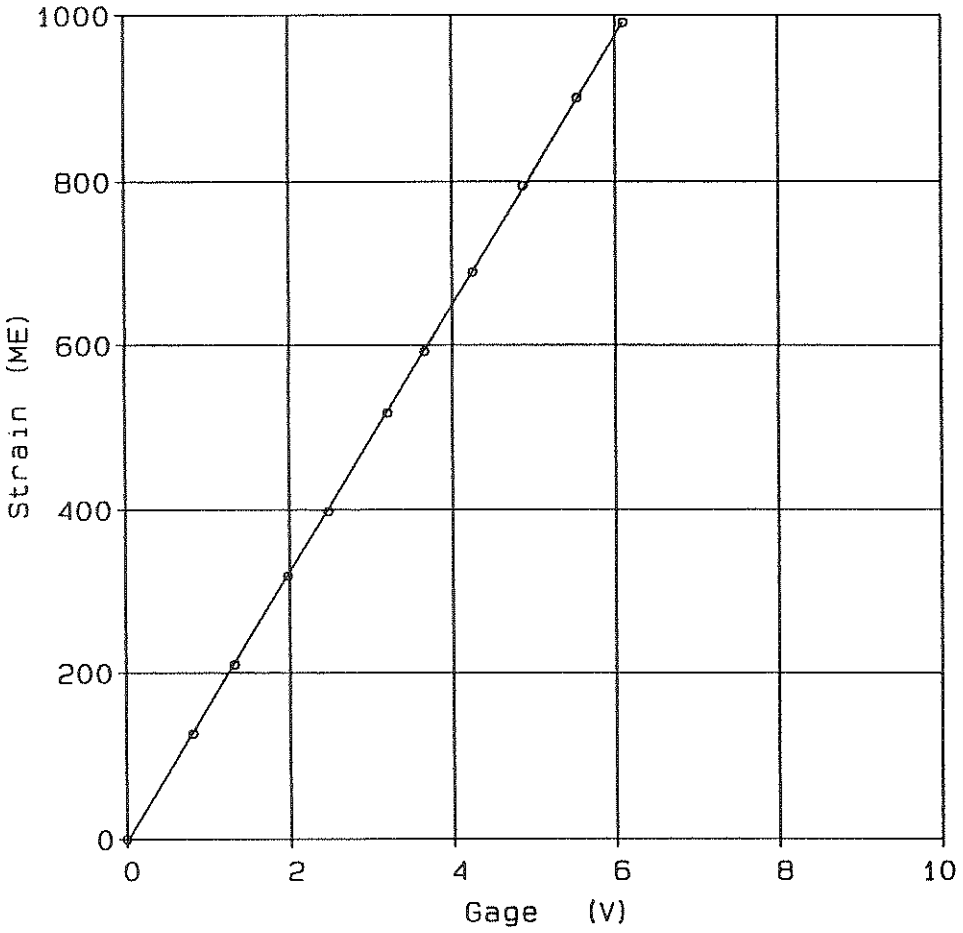

PDA Cal Factor = 163.2 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 566.6 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
128	.82
211	1.32
318	1.99
399	2.48
518	3.21
593	3.66
690	4.25
795	4.88
900	5.53
991	6.11

Calibrated by: J. Rutledge

Calibrated on: 07-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2