
Pile Dynamics Inc

Transducer 648W

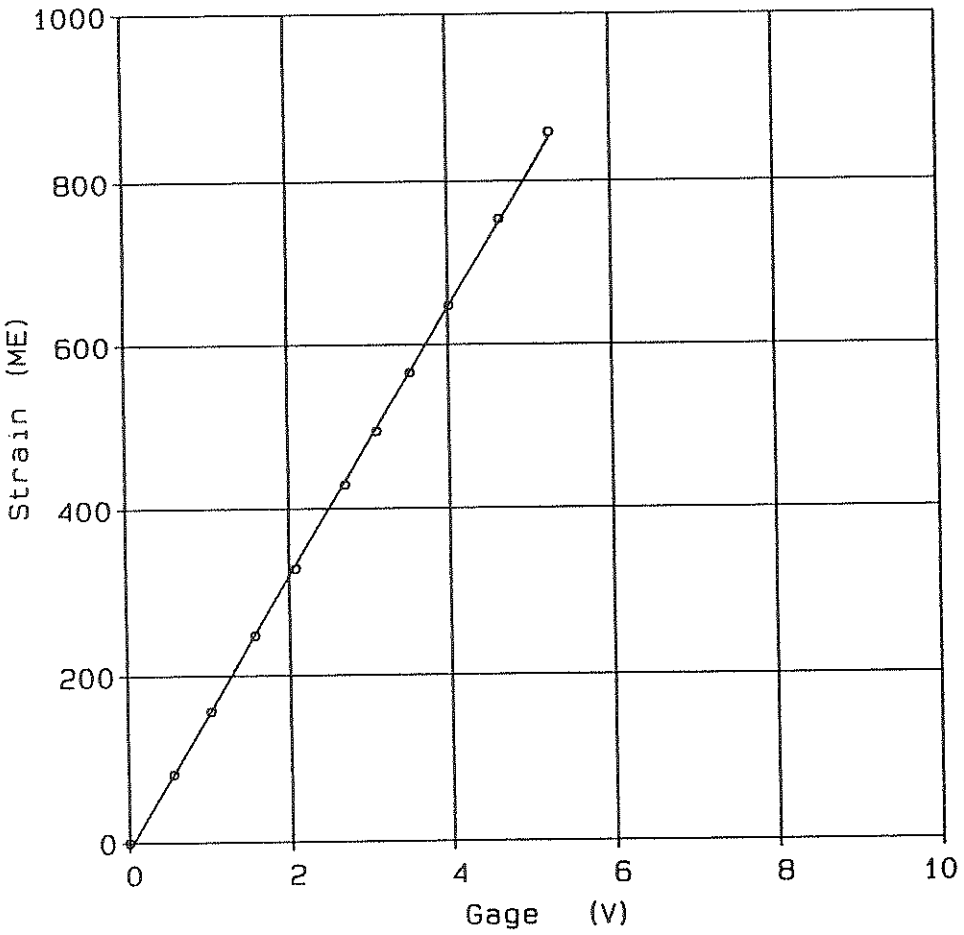

PDA Cal Factor	=	163.4 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	567.4 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
83	.55
158	1.02
247	1.58
328	2.08
429	2.70
494	3.10
567	3.53
647	4.02
755	4.65
858	5.26

Calibrated by: J.C. Rentschler

Calibrated on: 07-Jun-99