
Pile Dynamics Inc
Transducer 650W

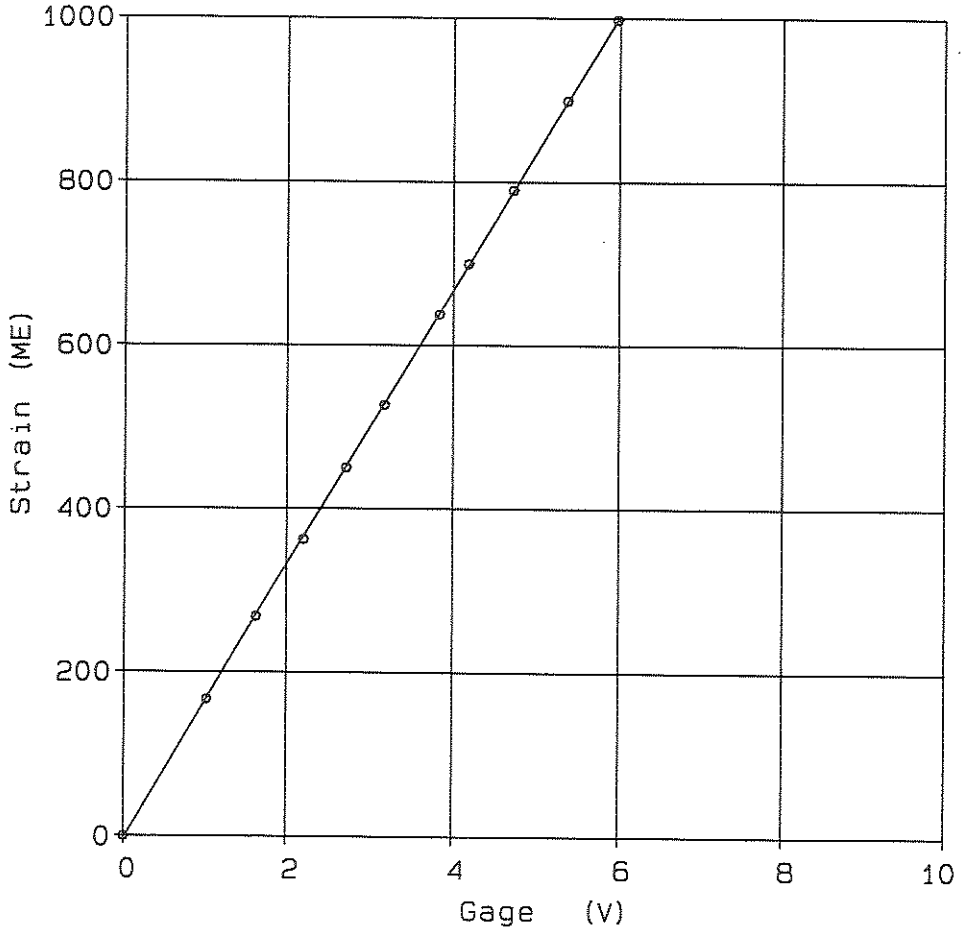

PDA Cal Factor = 168.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 583.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
167	1.03
268	1.64
363	2.20
450	2.72
527	3.17
639	3.83
700	4.19
791	4.73
899	5.37
999	5.97

Calibrated by: J. Rausch

Calibrated on: 09-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2