
Pile Dynamics Inc

Transducer 651W

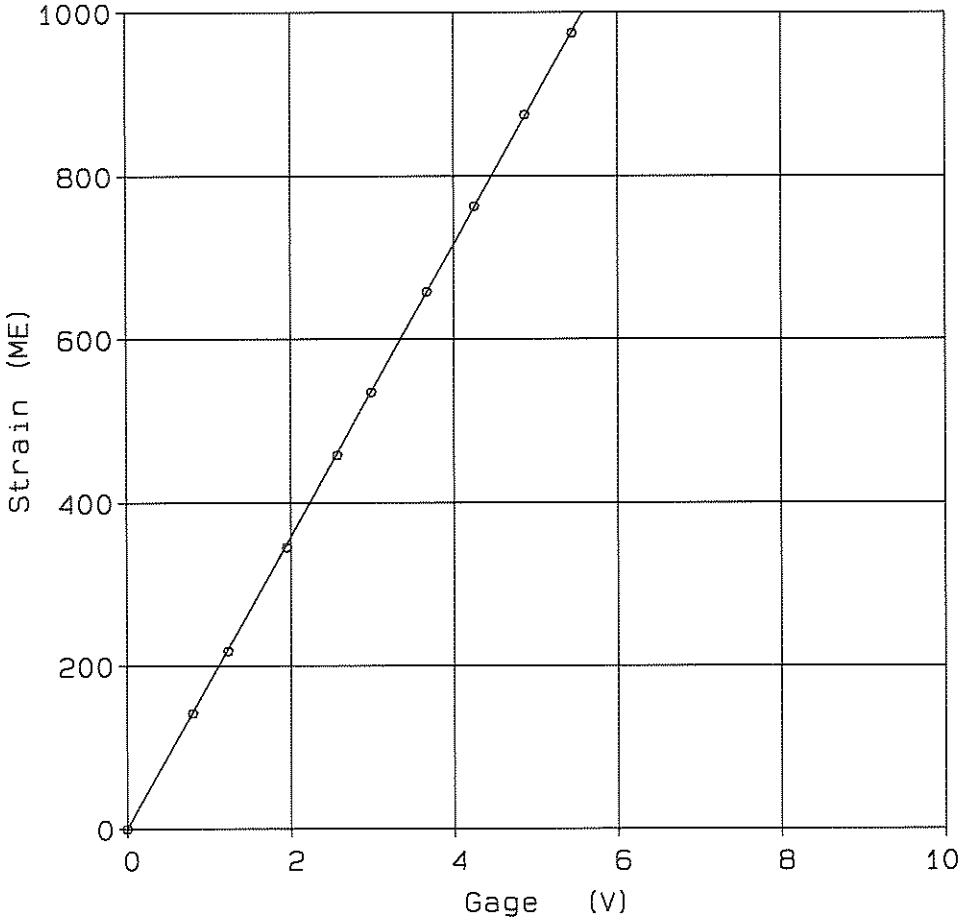

PDA Cal Factor	=	179.3 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	622.5 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
143	.80
219	1.24
346	1.95
459	2.57
536	3.00
659	3.67
763	4.25
875	4.87
976	5.45
1069	5.99

Calibrated by: J. Stavlas

Calibrated on: 09-Jun-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2