
# Pile Dynamics Inc
# Transducer 653W

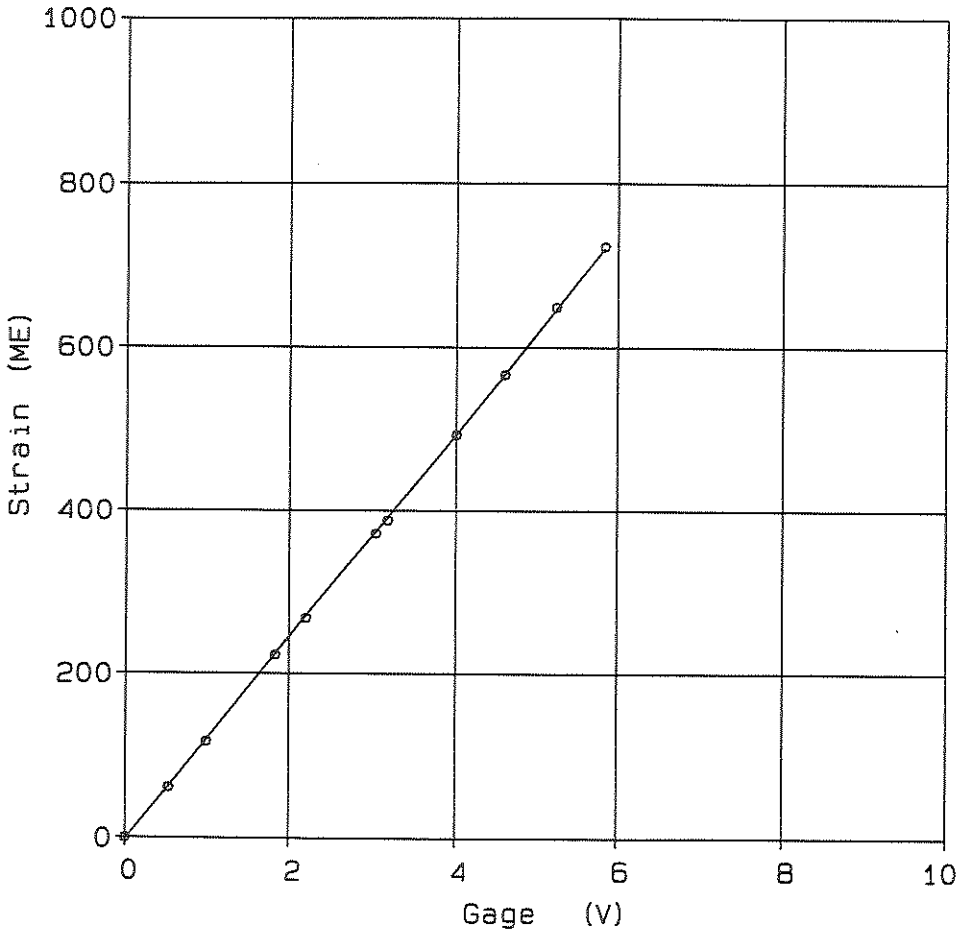


PDA Cal Factor = 124.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 430.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

| Strain ME | Gage V |
|---|---|
| 0 | .00 |
| 62 | .53 |
| 118 | .98 |
| 223 | 1.83 |
| 269 | 2.22 |
| 373 | 3.04 |
| 389 | 3.19 |
| 493 | 4.01 |
| 568 | 4.60 |
| 649 | 5.25 |
| 723 | 5.85 |

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 14-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2