
Pile Dynamics Inc
Transducer 654W

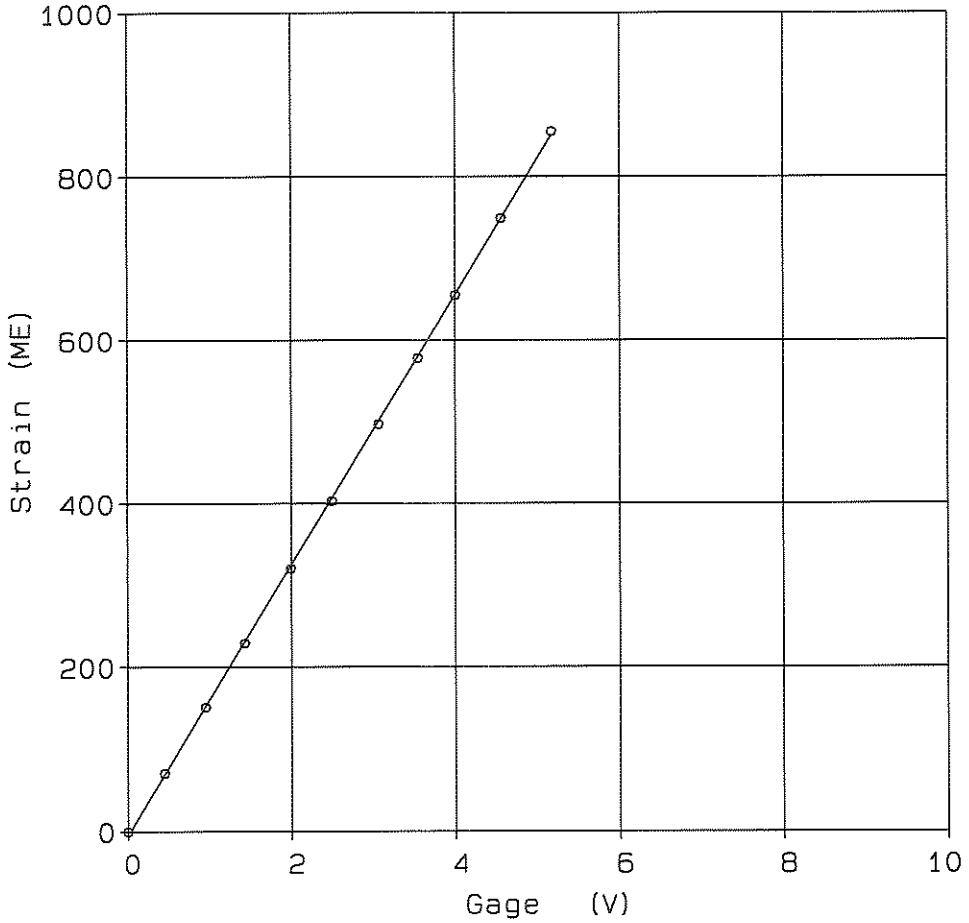

PDA Cal Factor = 165.0 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 573.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
71	.45
151	.95
229	1.44
320	1.99
403	2.49
498	3.06
579	3.55
656	4.01
749	4.56
856	5.19

Calibrated by: _____

Calibrated on: 29-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2