
Pile Dynamics Inc
Transducer 655W

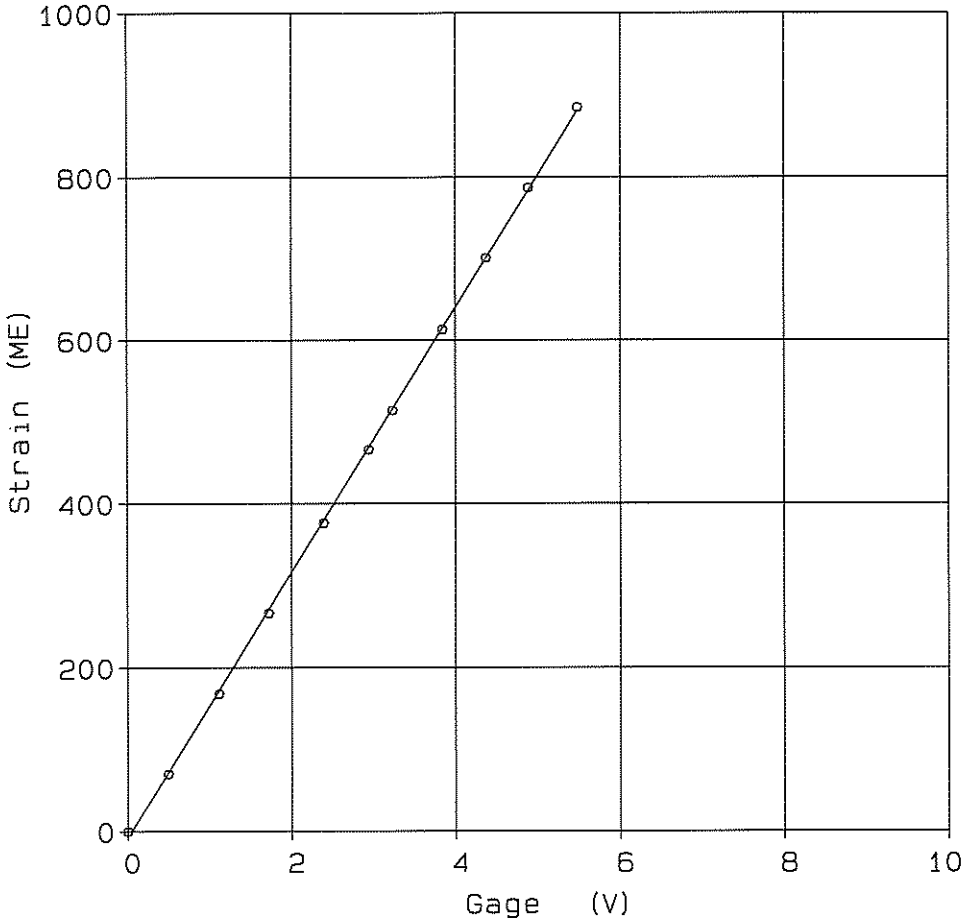

PDA Cal Factor = 162.5 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 564.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
70	.49
168	1.11
266	1.72
376	2.39
467	2.95
515	3.23
613	3.85
702	4.37
788	4.89
885	5.48

Calibrated by: J. Rausche

Calibrated on: 29-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2