
Pile Dynamics Inc
Transducer 656W

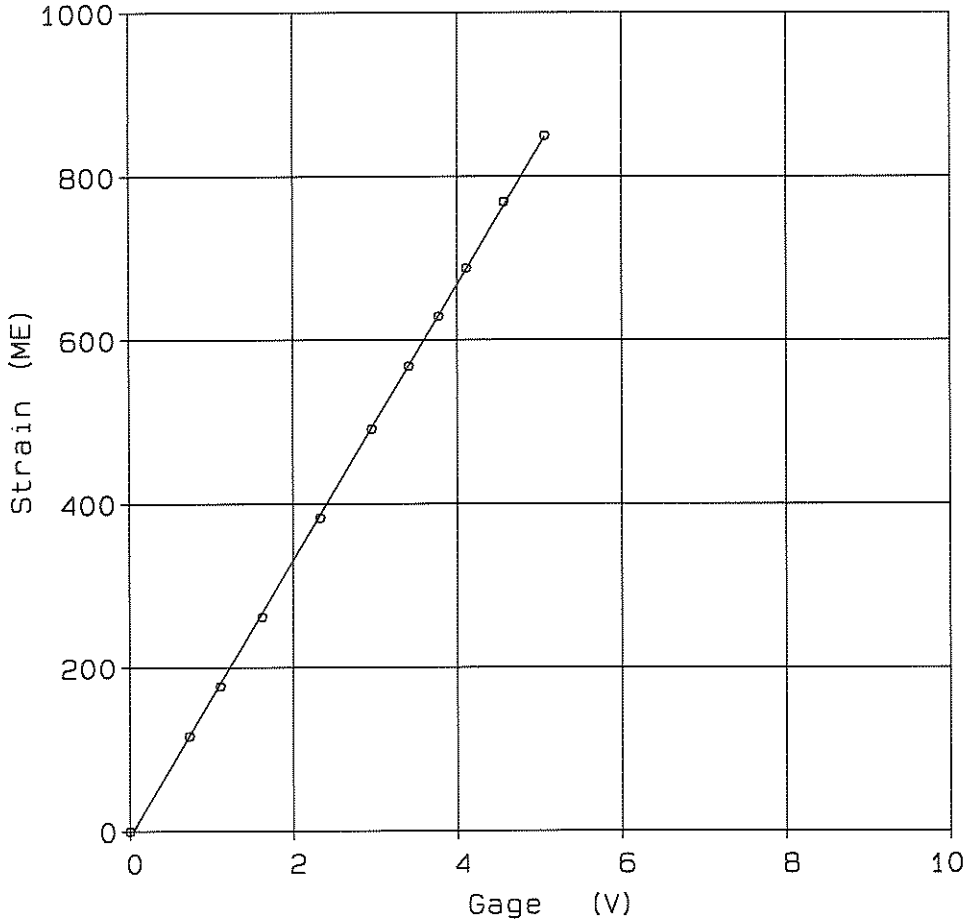

PDA Cal Factor	=	168.7 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	585.9 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
117	.73
178	1.11
263	1.62
383	2.34
491	2.97
568	3.42
630	3.78
688	4.11
769	4.58
851	5.08

Calibrated by: J. Dowdell

Calibrated on: 29-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2