
Pile Dynamics Inc

Transducer 657W

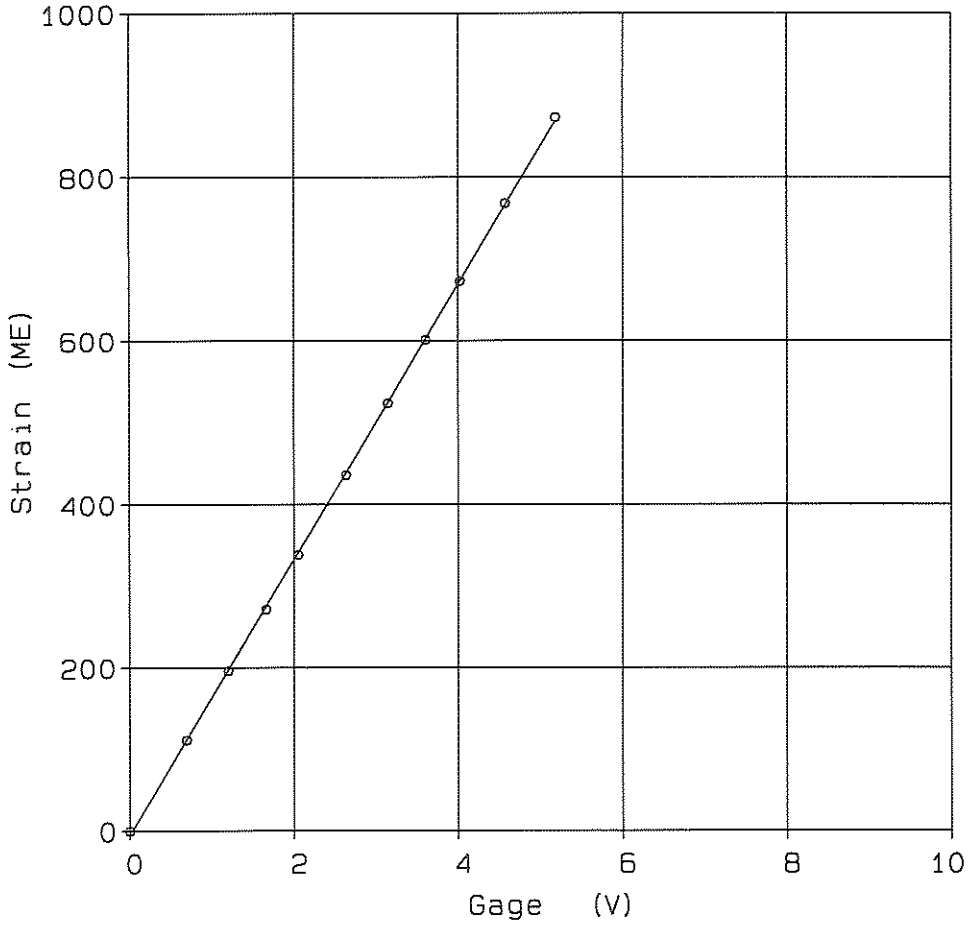

PDA Cal Factor = 169.1 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 587.3 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
112	.70
196	1.21
272	1.66
338	2.06
437	2.64
525	3.15
601	3.60
673	4.02
769	4.57
874	5.18

Calibrated by: _____

Calibrated on: 29-Jul-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2