
Pile Dynamics Inc

Transducer 660W

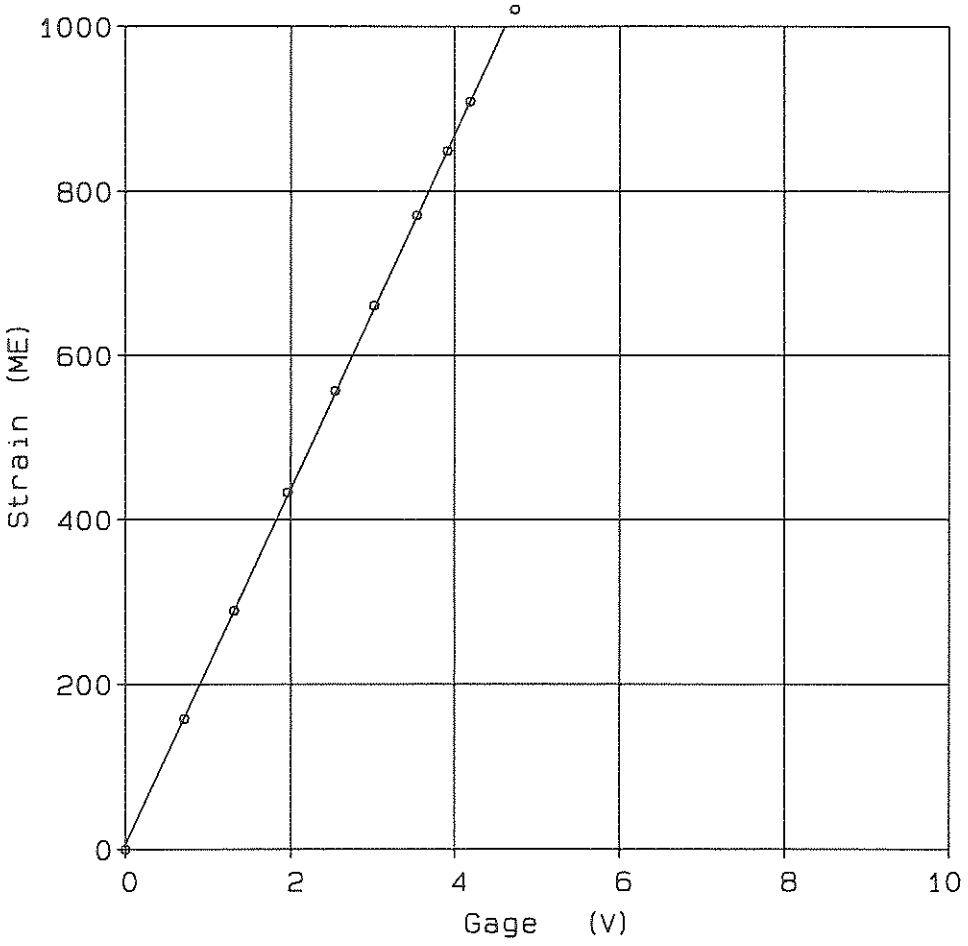

PDA Cal Factor	=	215.1 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	746.7 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
158	.72
289	1.31
433	1.97
558	2.54
661	3.02
772	3.54
849	3.91
909	4.20
1021	4.73
1119	5.21

Calibrated by: J. Rawlings

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2