
Pile Dynamics Inc

Transducer 662W

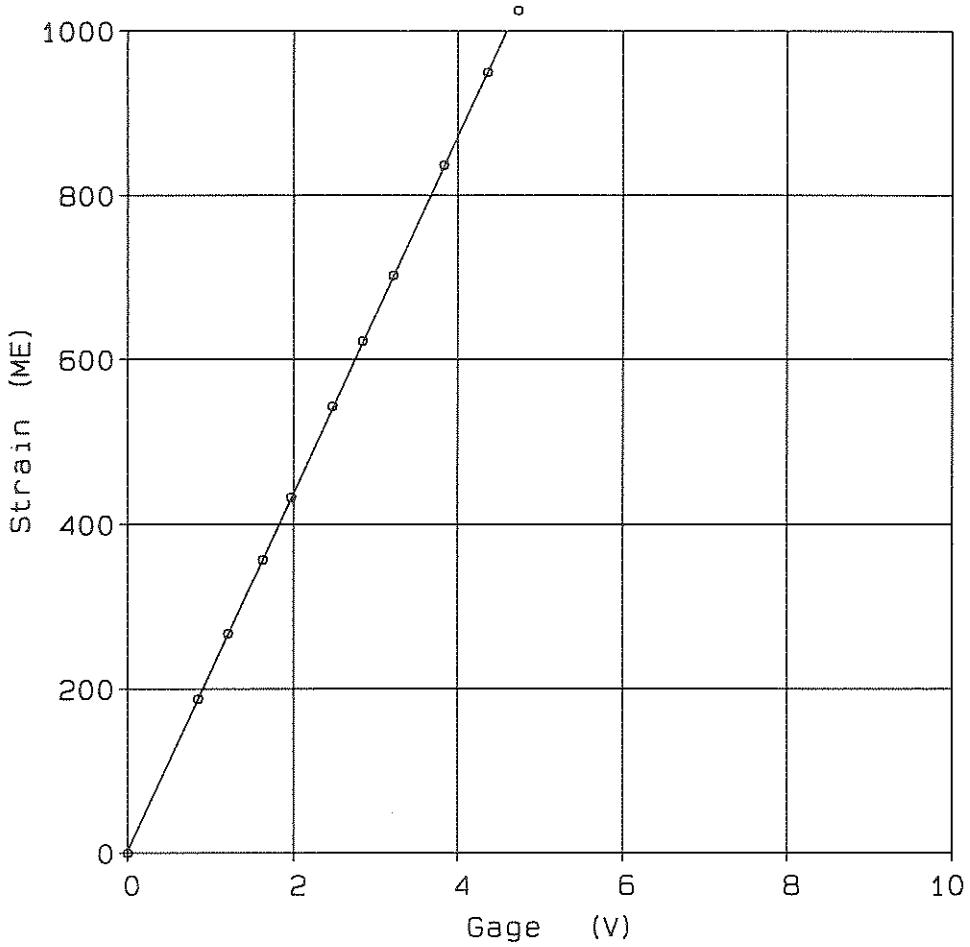

PDA Cal Factor = 216.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 752.9 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
189	.85
267	1.22
358	1.63
433	1.98
543	2.47
623	2.84
703	3.21
838	3.84
950	4.37
1025	4.74

Calibrated by: J. Rohde

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2