
Pile Dynamics Inc

Transducer 664W

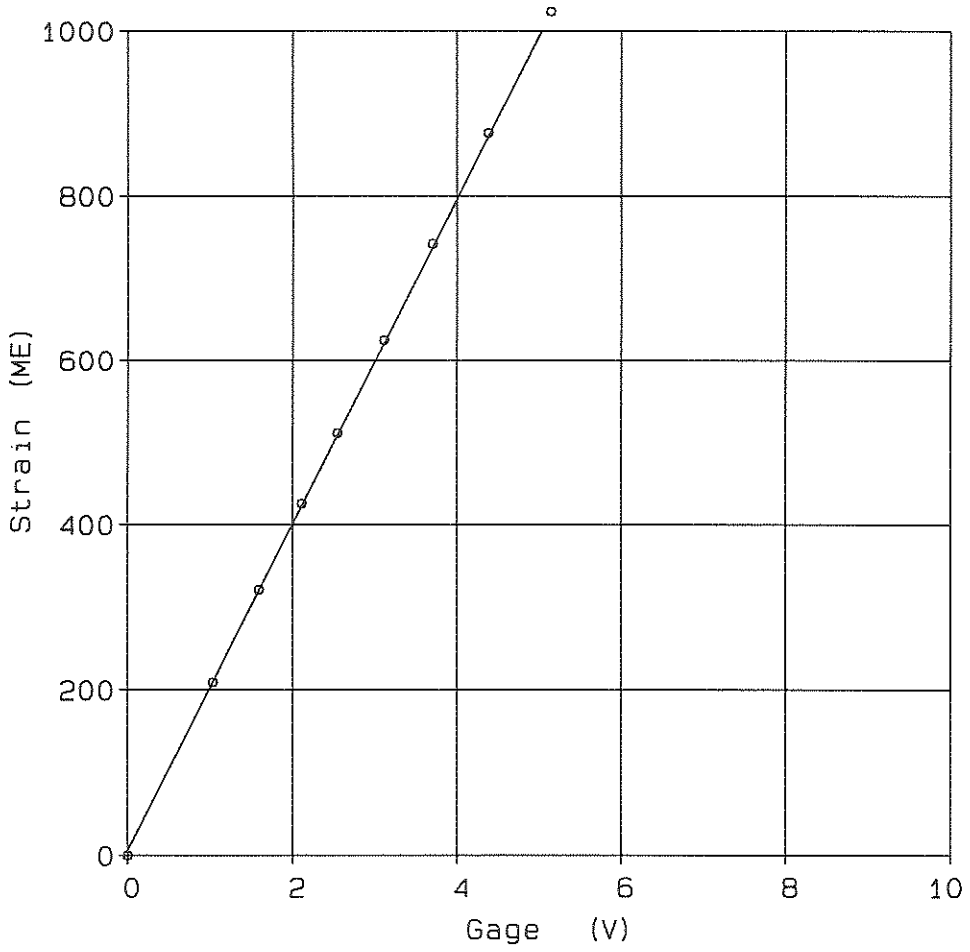

PDA Cal Factor = 197.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 685.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
209	1.03
321	1.59
426	2.12
511	2.54
626	3.11
743	3.71
877	4.39
1025	5.15
1136	5.74
1223	6.21

Calibrated by: J. Stentoft

Calibrated on: 13-Sep-99

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2