
Pile Dynamics Inc
Transducer 680W

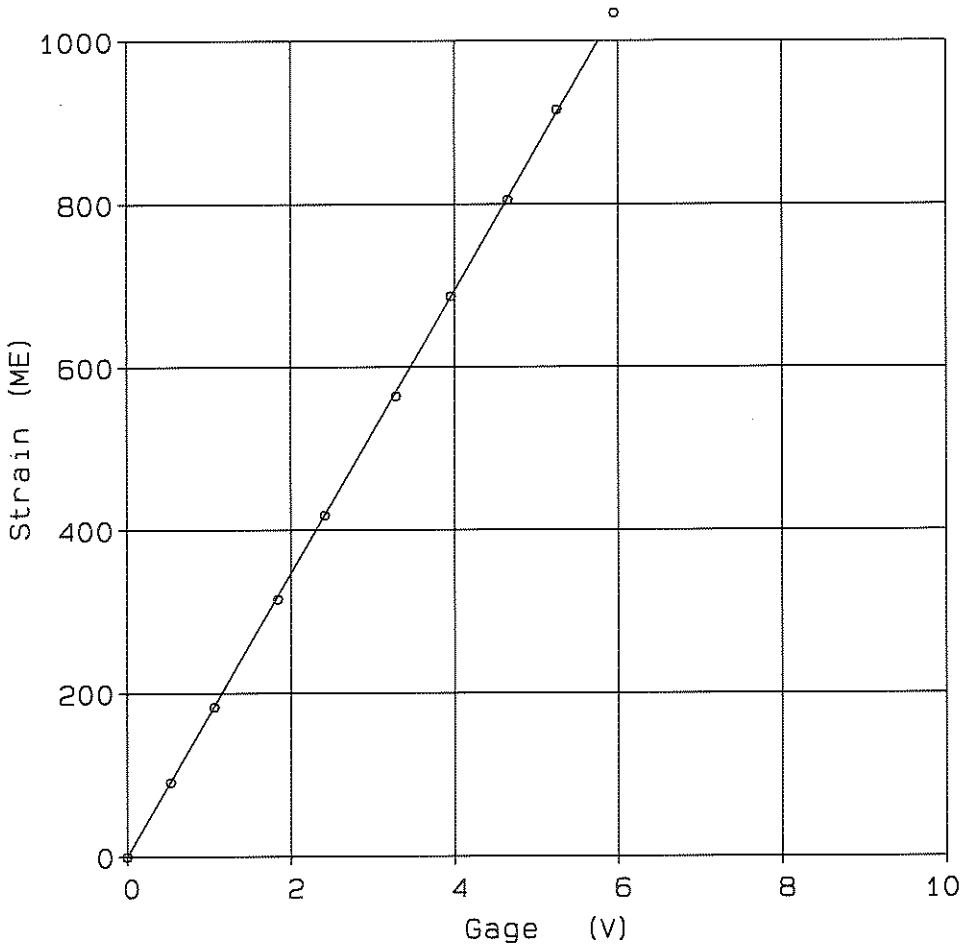

PDA Cal Factor = 173.8 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 603.4 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
92	.53
184	1.06
315	1.84
418	2.41
564	3.28
688	3.95
805	4.65
916	5.26
1035	5.95
1150	6.64

Calibrated by: _____

Calibrated on: 16-Jul-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2