
Pile Dynamics Inc

Transducer 681W

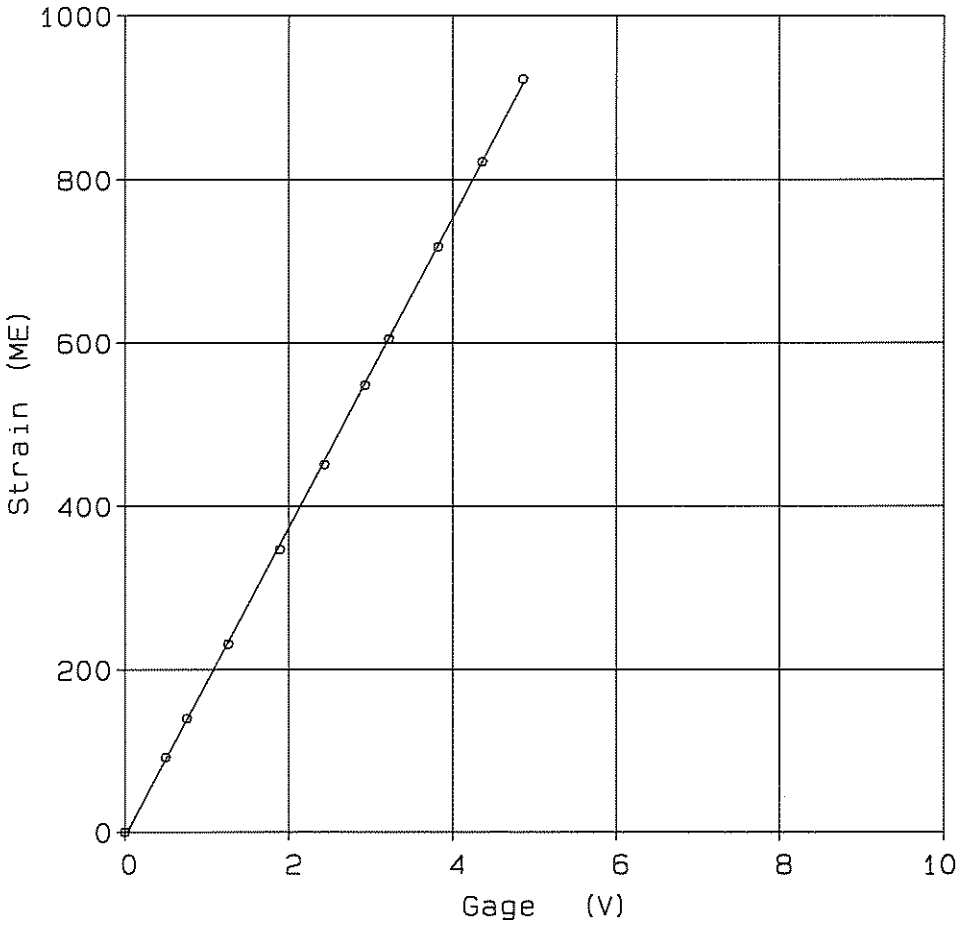

PDA Cal Factor = 189.7 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 658.8 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
92	.51
140	.77
231	1.27
348	1.89
452	2.44
548	2.94
605	3.23
719	3.82
822	4.36
924	4.87

Calibrated by: _____

Calibrated on: 23-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2