
Pile Dynamics Inc

Transducer 682W

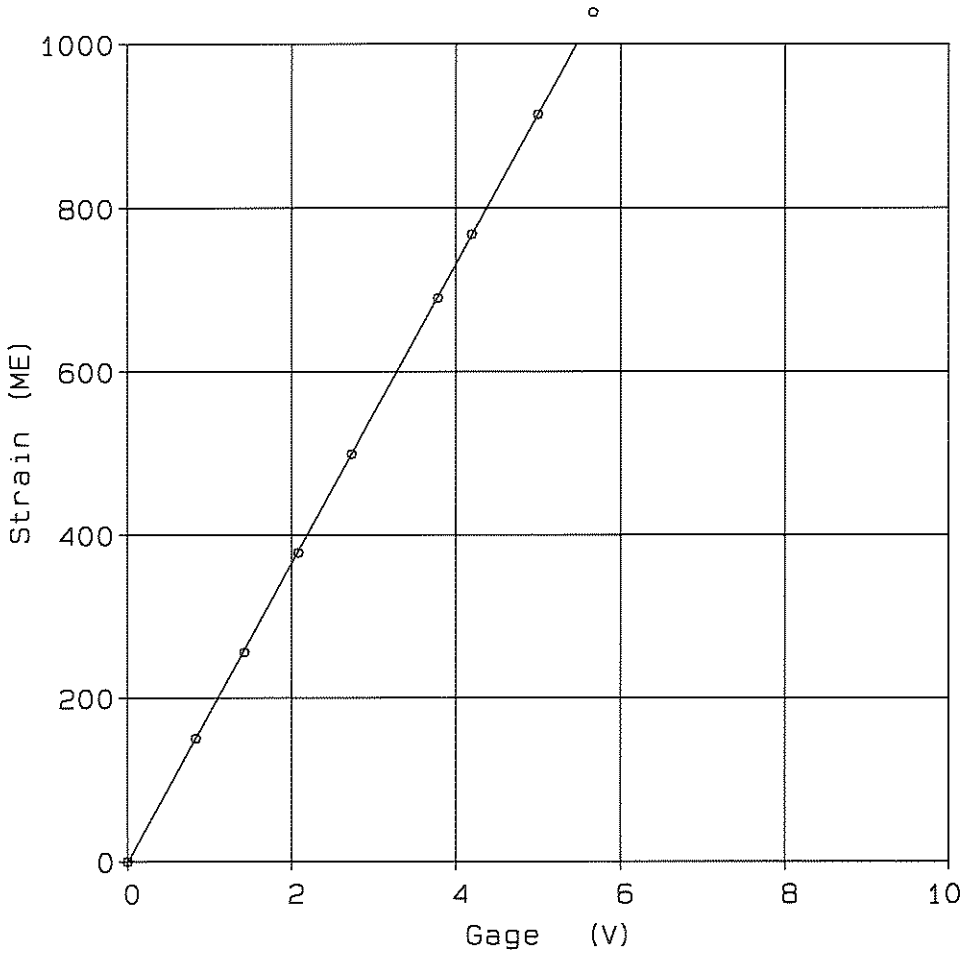

PDA Cal Factor	=	183.2 ME/V
Shunt (60.4KO)	=	5.0 V
General Factor	=	636.2 ME/mV/V

Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
150	.83
257	1.42
379	2.08
499	2.74
690	3.78
769	4.20
914	5.00
1040	5.67
1151	6.29
1267	6.94

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 23-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2