
Pile Dynamics Inc
Transducer 685W

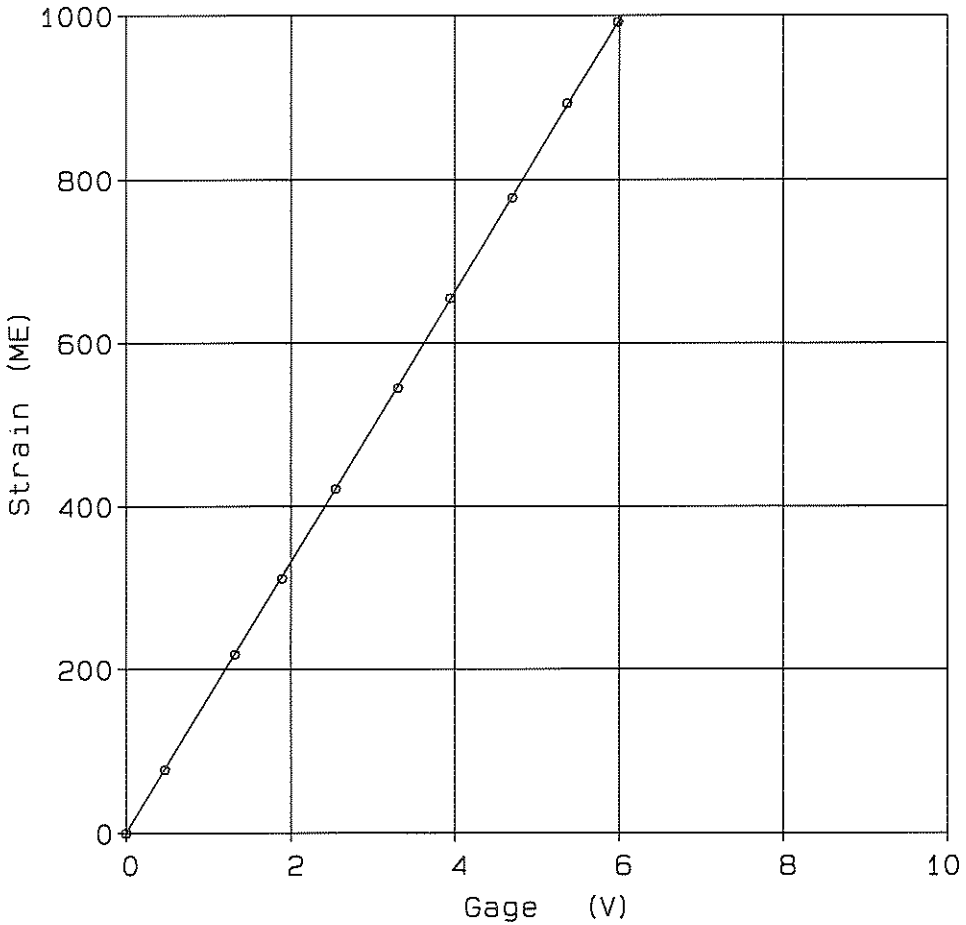

PDA Cal Factor = 165.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 576.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
78	.47
218	1.33
312	1.90
422	2.55
546	3.31
655	3.94
779	4.70
894	5.37
993	5.99
1144	6.92

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 23-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2