
Pile Dynamics Inc

Transducer 686W

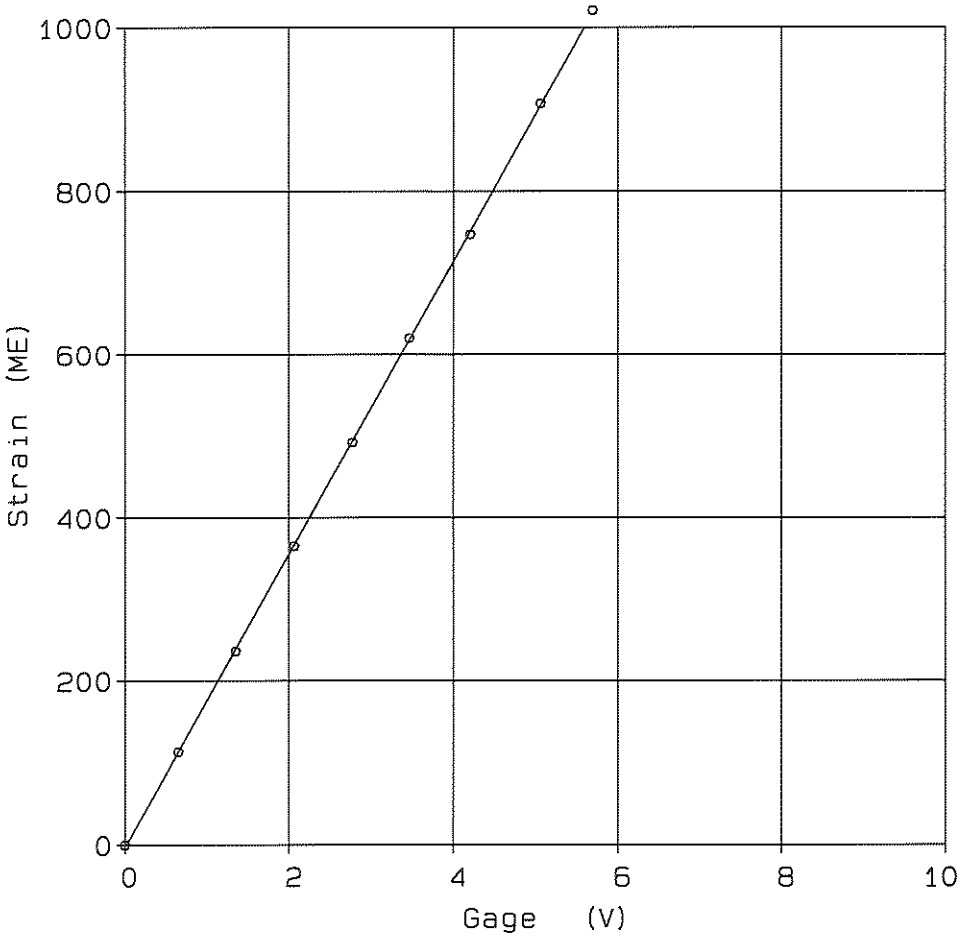

PDA Cal Factor = 179.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 623.0 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
113	.66
237	1.35
365	2.06
492	2.78
620	3.46
748	4.20
907	5.06
1022	5.70
1124	6.28
1281	7.17

Calibrated by: J. Pantchyl

Calibrated on: 23-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2