
Pile Dynamics Inc

Transducer 687W

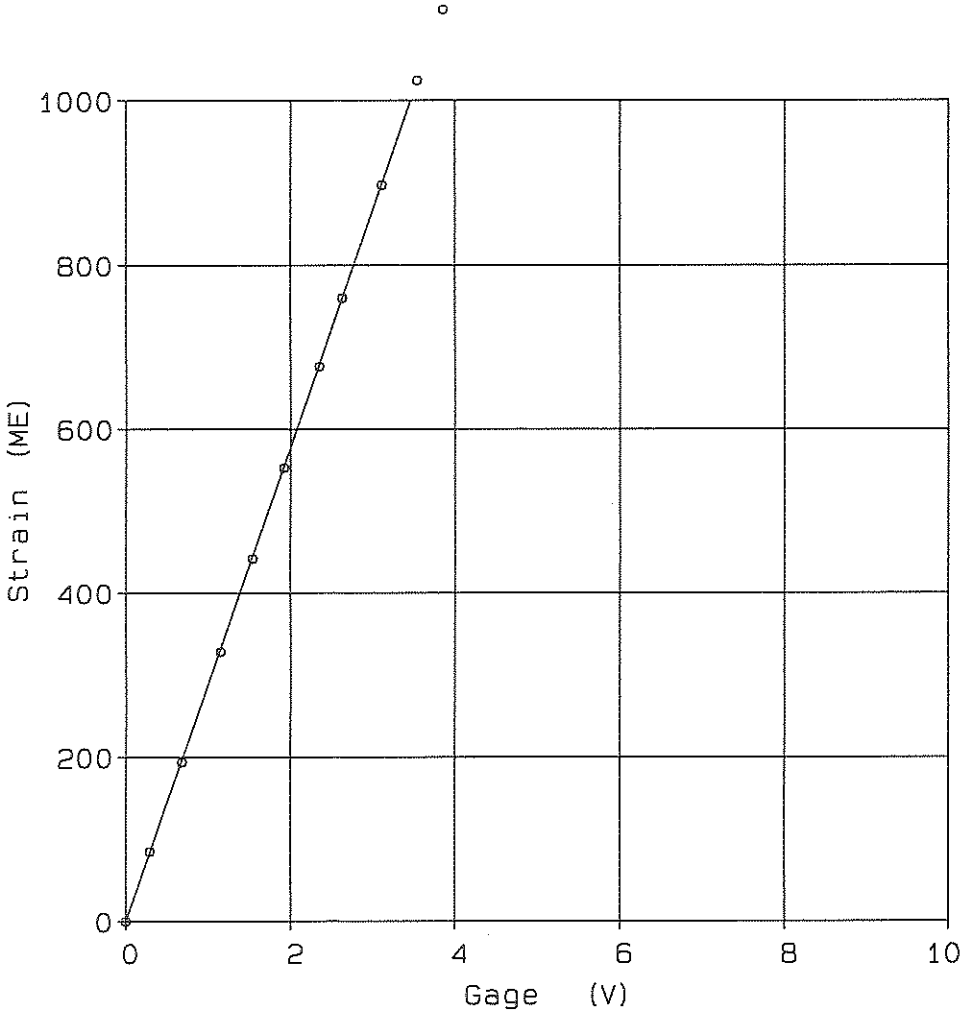

PDA Cal Factor = 288.9 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 1003.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
86	.30
195	.69
329	1.15
443	1.54
554	1.93
678	2.35
760	2.63
897	3.11
1025	3.54
1111	3.86

Calibrated by: J. Rentelle

Calibrated on: 02-Apr-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2