
Pile Dynamics Inc

Transducer 689W

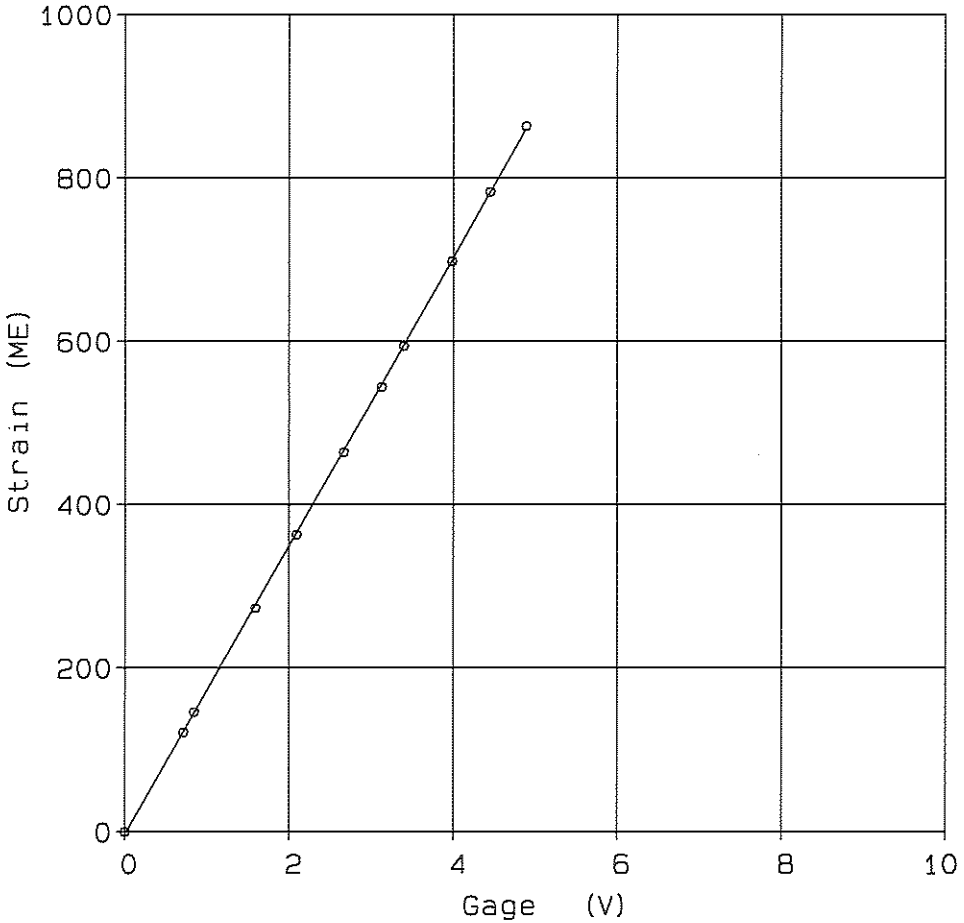

PDA Cal Factor = 176.4 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 612.7 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
121	.71
147	.85
273	1.59
364	2.10
465	2.67
545	3.13
595	3.39
699	3.98
783	4.45
863	4.90

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 28-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2