
Pile Dynamics Inc

Transducer 690W

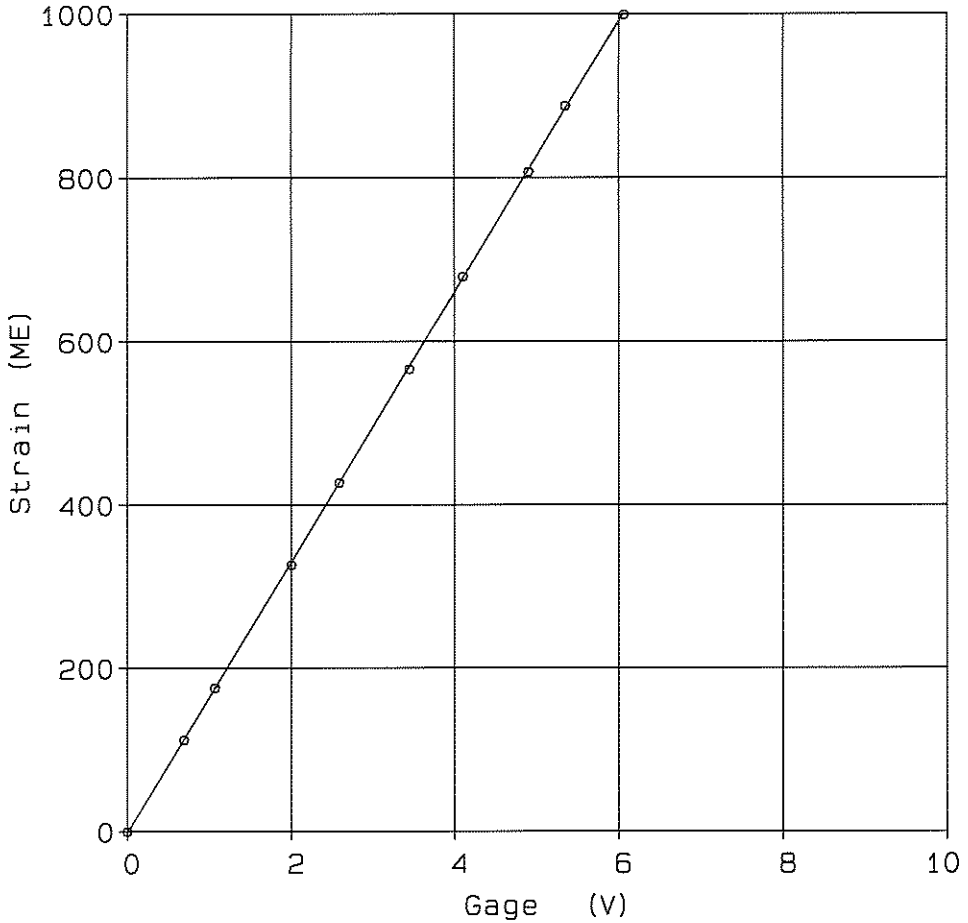

PDA Cal Factor = 165.3 ME/V
Shunt (60.4KO) = 5.0 V

General Factor = 574.1 ME/mV/V
Traceable to N.I.S.T.

Strain ME	Gage V
0	.00
113	.70
176	1.07
326	2.01
427	2.59
567	3.45
680	4.11
808	4.90
887	5.35
1000	6.06
1136	6.89

Calibrated by: J. Deutsch

Calibrated on: 28-Mar-01

Strain Transducer Calibration System - Version 1994-2